


MEDVIE


Date du test: 04/07/2025 13:21:40
Durée: 4mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		YUANXING SUN
Date de naissance	26/11/1981	
Age	43	
Société	CR18	
ID	25070413182722907	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

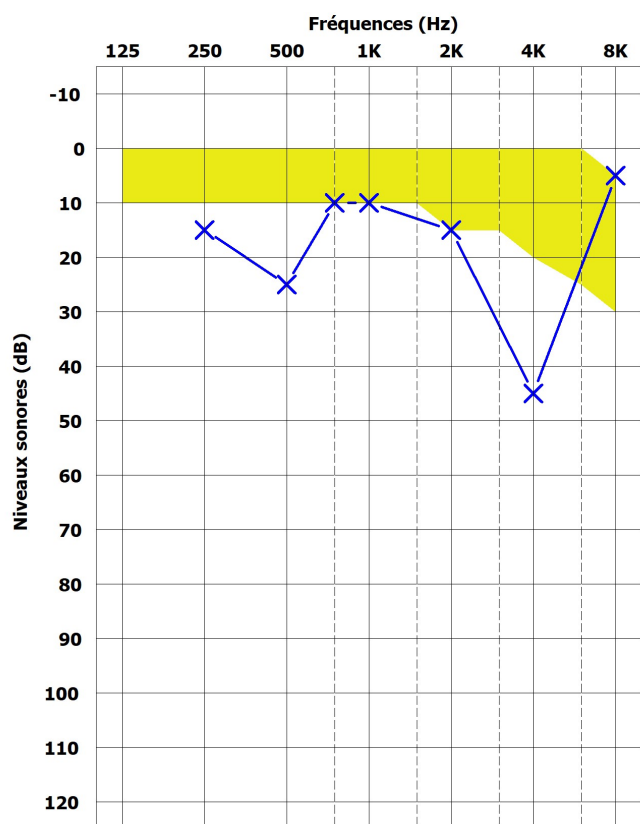

Oreille Gauche

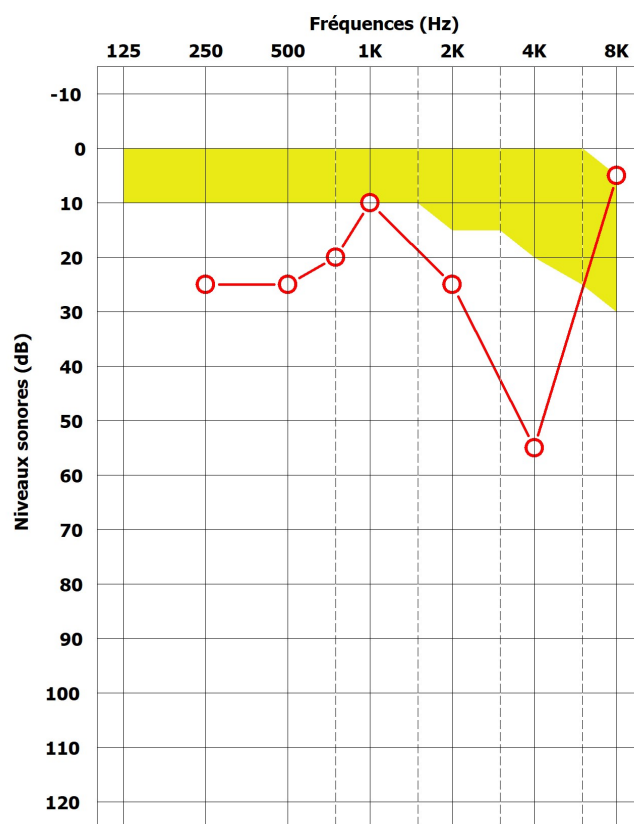

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	10	10		15		45		5
CA Droit		25	25	20	10		25		55		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes