


MEDVIE


Date du test: 29/02/2024 14:25:04

Durée: 4mn 40s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

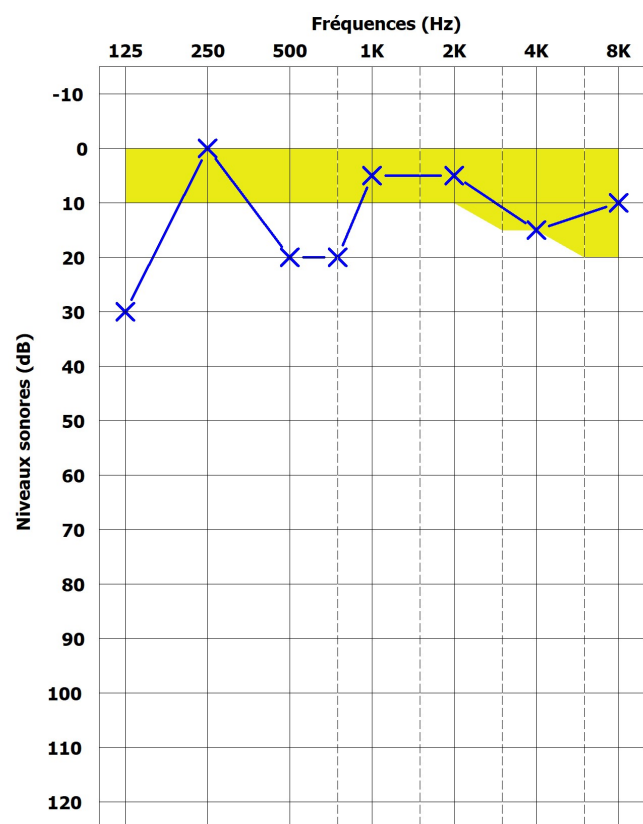

Oreille Gauche

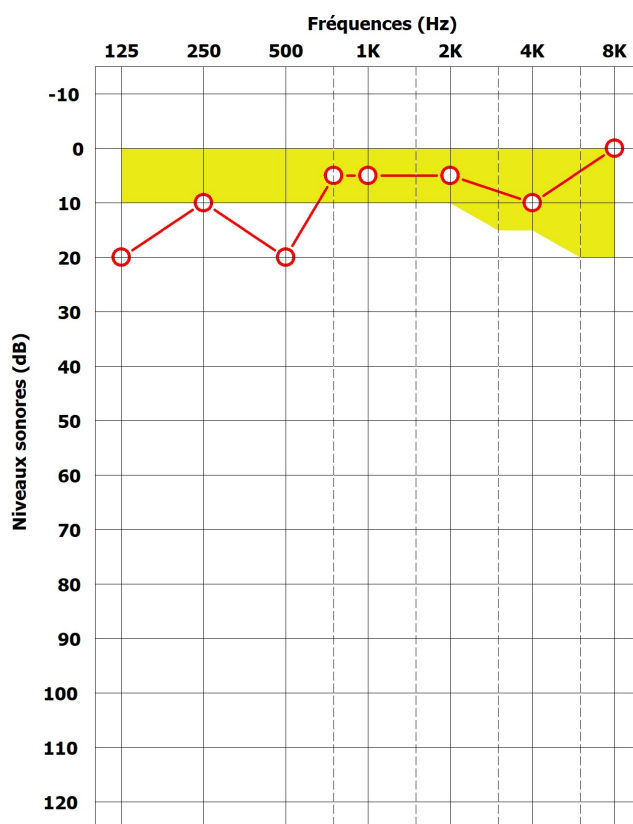

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	0	20	20	5		5		15		10
CA Droit	20	10	20	5	5		5		10		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	SANOH MORIBA
Date de naissance	01/01/1985
Age	39
Société	CR18
ID	24022914222625244

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021