


MEDVIE


Date du test: 30/06/2025 19:14:49
Durée: 3mn 03s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHENG XIANG	
Date de naissance	12/01/1988
Age	37
Société	CR18
ID	25063019073614745

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

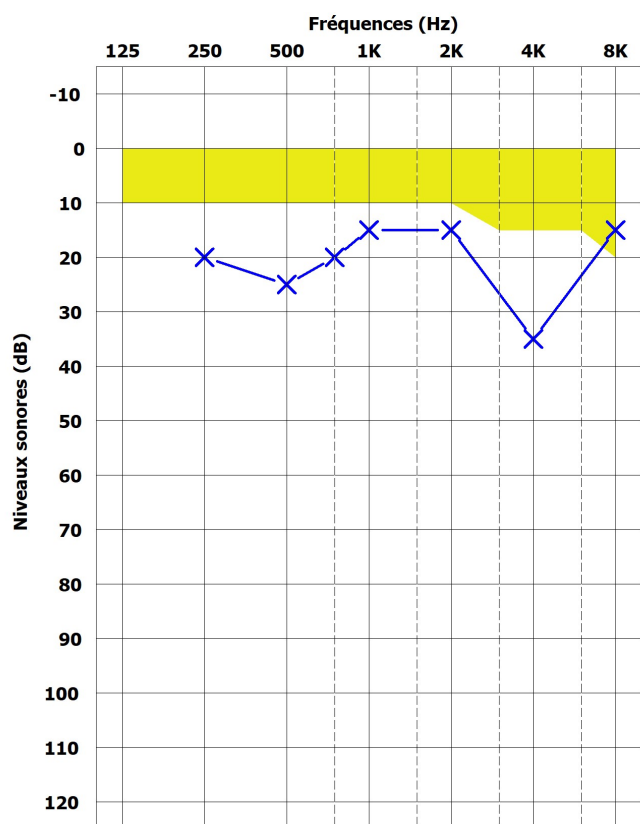

Oreille Gauche

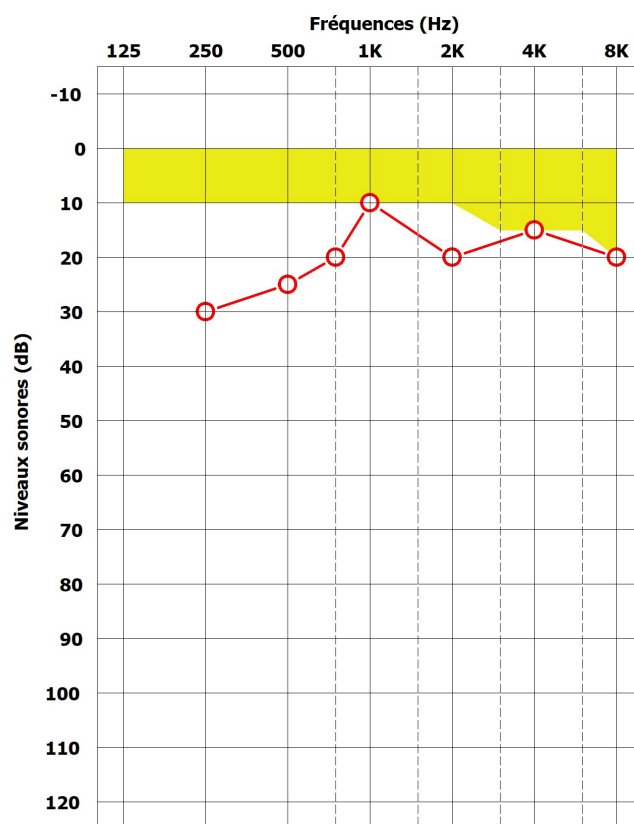

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	20	15		15		35		15
CA Droit		30	25	20	10		20		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes