


MEDVIE

Date du test: 29/09/2024 18:37:54

Durée: 6mn 09s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

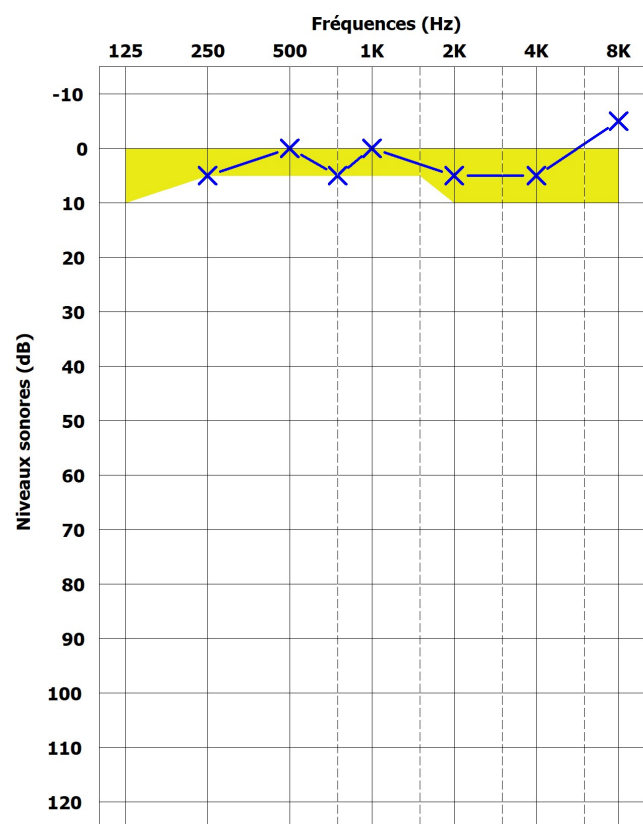

Oreille Gauche

Données Patient	
CONDE CHEICK FANTIA MARY	
Date de naissance	02/05/1999
Age	25
Société	CR18
ID	24092918135562751

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

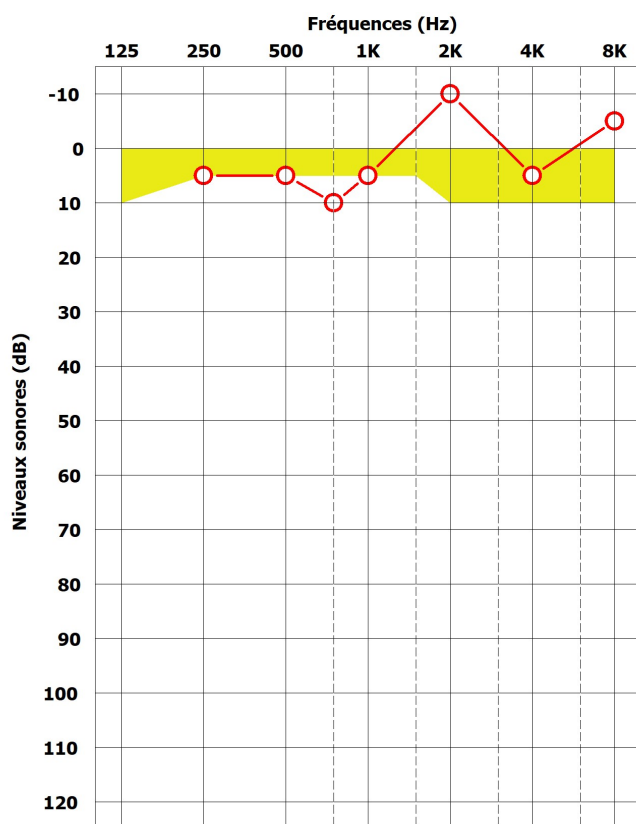

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	0	5	0		5		5		-5
CA Droit		5	5	10	5		-10		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes