

MEDVIE

Date du test: 29/07/2025 16:48:56

Durée: 4mn 41s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **KOUROUMA NAMORY**

Date de naissance 01/01/1982

Age 43

Société CR18


ID 25072916430486546

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

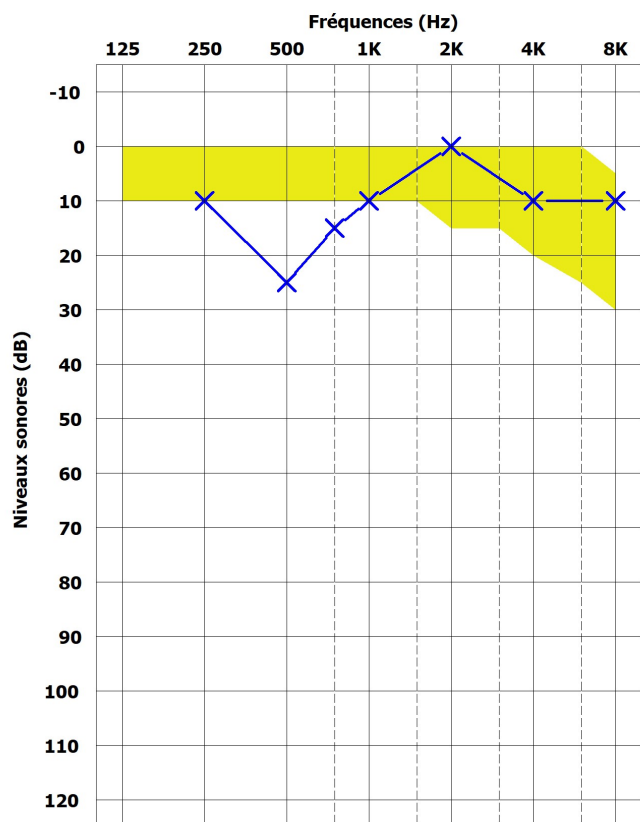

Oreille Gauche

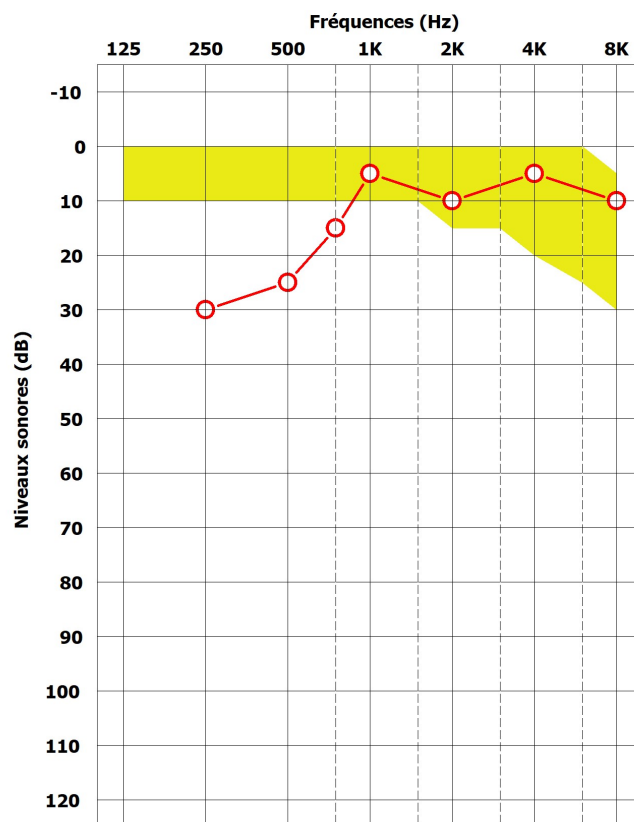

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	15	10		0		10		10
CA Droit		30	25	15	5		10		5		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes