



Données Patient		FOFANA OUSMANE
Date de naissance		01/01/1990
Age		34
Société		CR18
ID		24050715501613757

Date du test: 07/05/2024 17:15:28
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

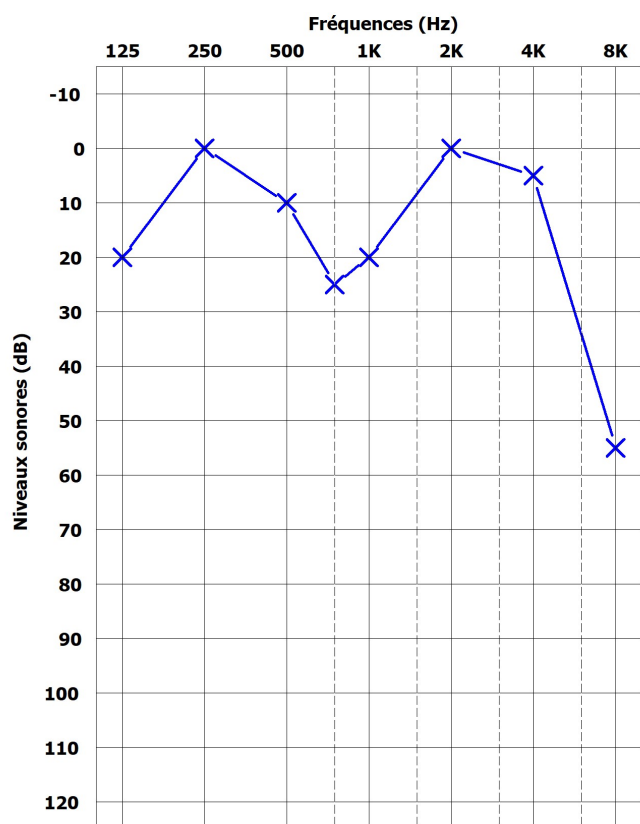

Oreille Gauche

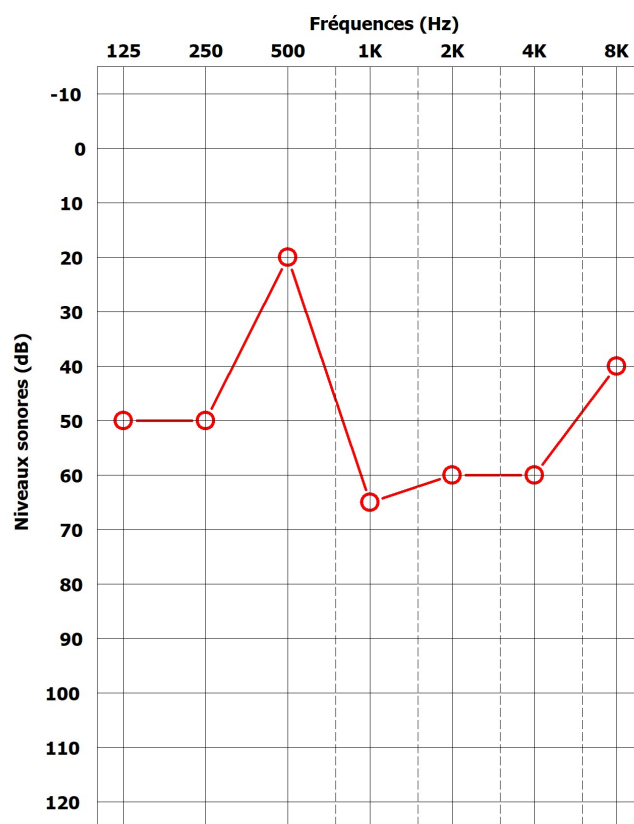

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	0	10	25	20		0		5		55
CA Droit	50	50	20		65		60		60		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	51,3 dB	---

Notes