


MEDVIE


Date du test: 27/05/2024 16:16:46
Durée: 0mn 58s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
SONOMOU ABRAHAM	
Date de naissance	01/01/2002
Age	22
Société	CR18
ID	24050716534993619

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

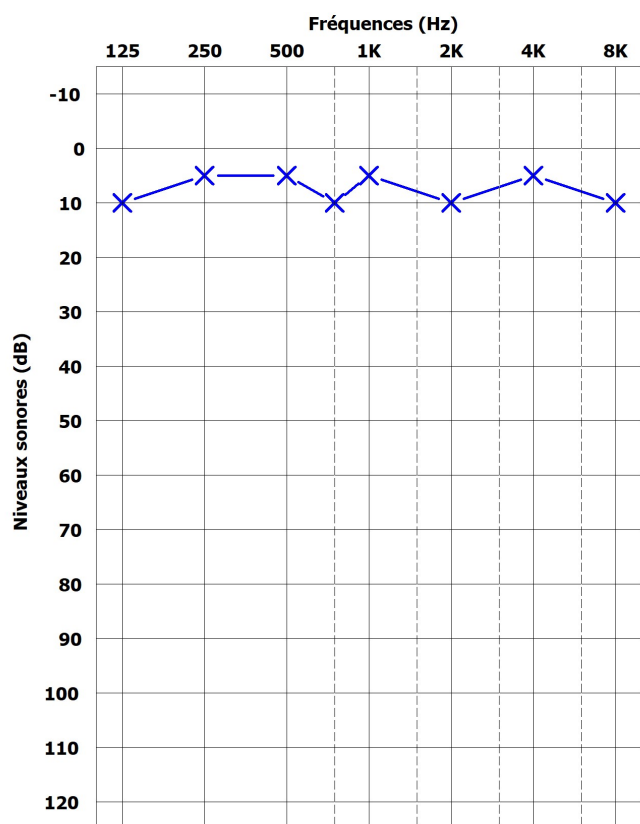

Oreille Gauche

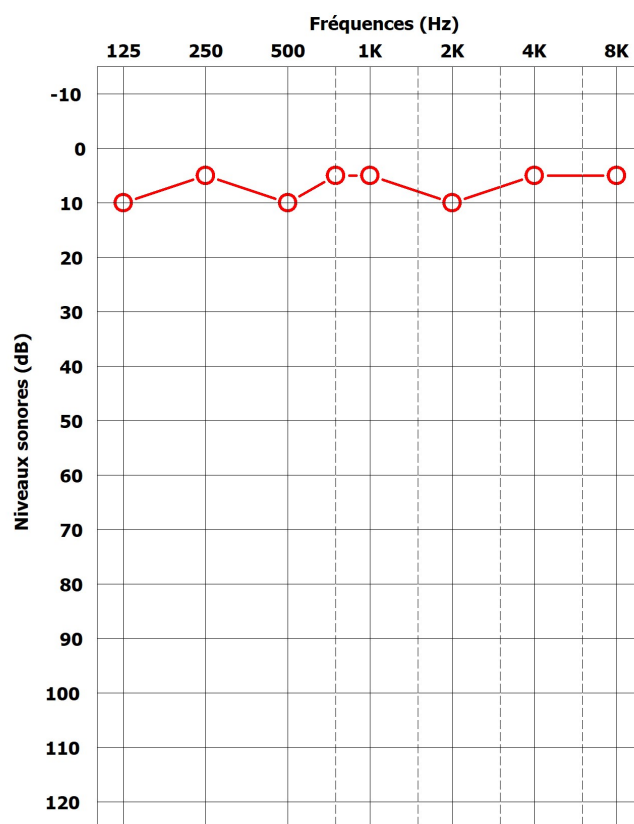

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	5	5	10	5		10		5		10
CA Droit	10	5	10	5	5		10		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes