


MEDVIE


Date du test: 20/05/2024 14:13:32
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient	
DOUMBOUYA NOUHAN	
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	CR18
ID	24052014082039396

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

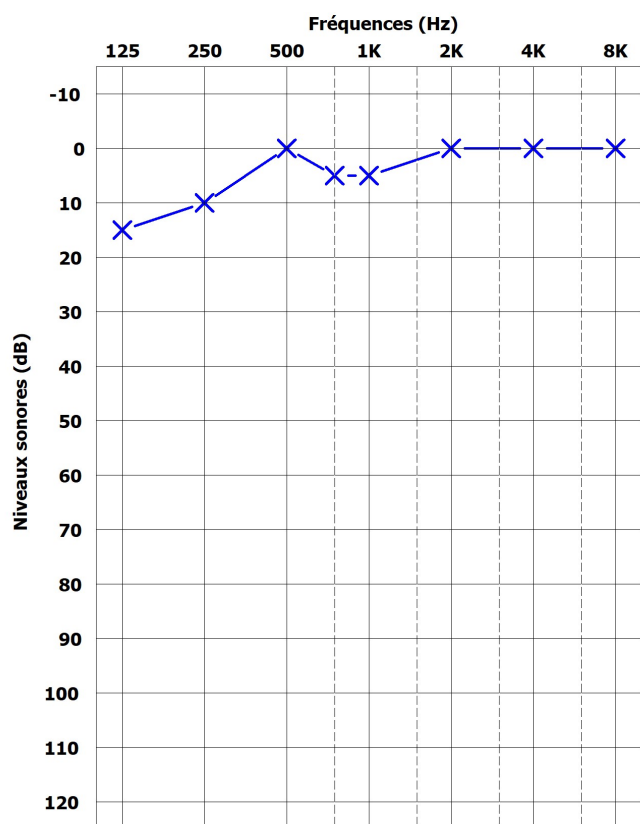

Oreille Gauche

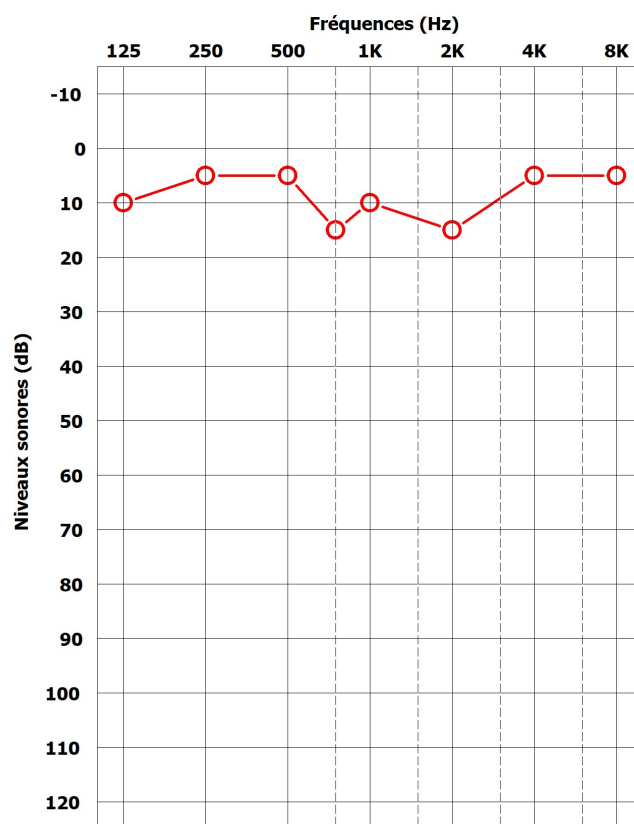

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	0	5	5		0		0		0
CA Droit	10	5	5	15	10		15		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes