


MEDVIE


Date du test: 05/03/2025 15:22:12
Durée: 4mn 36s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
KEITA N'FALY	
Date de naissance	01/01/1989
Age	36
Société	CR18
ID	25030514590402612

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

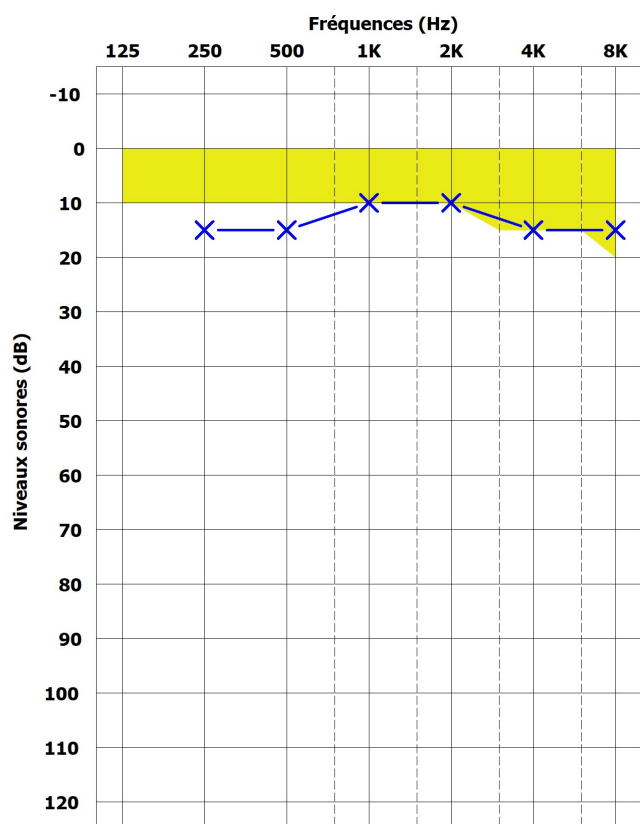

Oreille Gauche

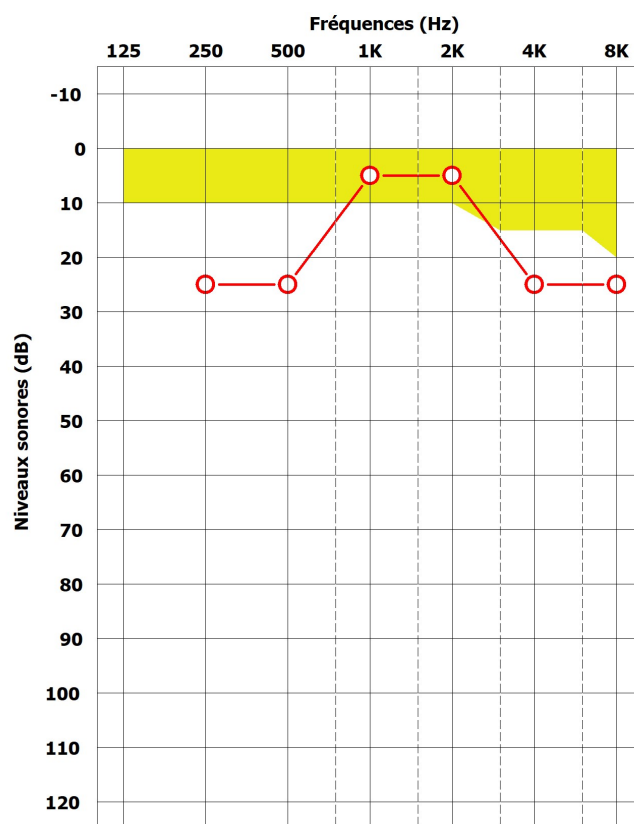

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15		10		10		15		15
CA Droit		25	25		5		5		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes