


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 12:41:32
Durée: 4mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUMBOUYA DAOUDA	
Date de naissance	15/05/1985
Age	39
Société	CR18
ID	25031412232839837

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

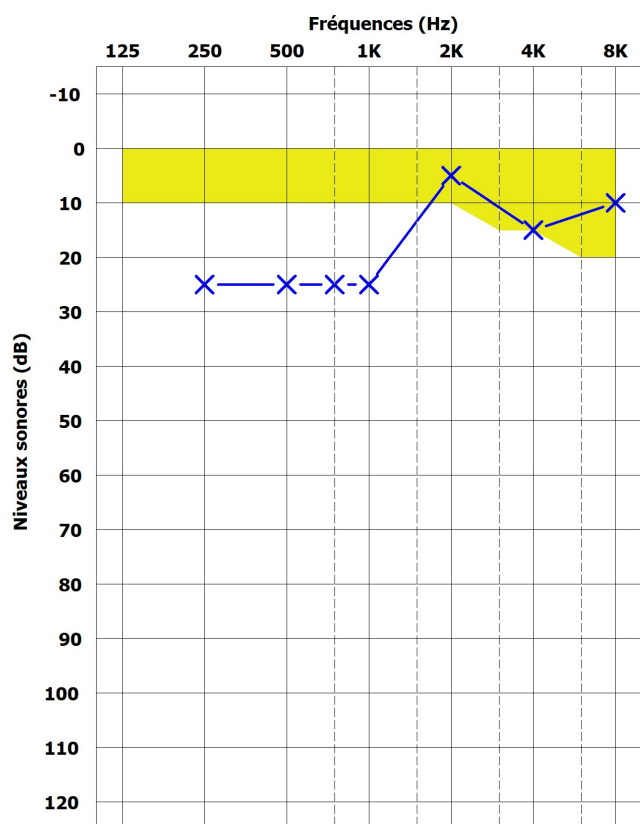

Oreille Gauche

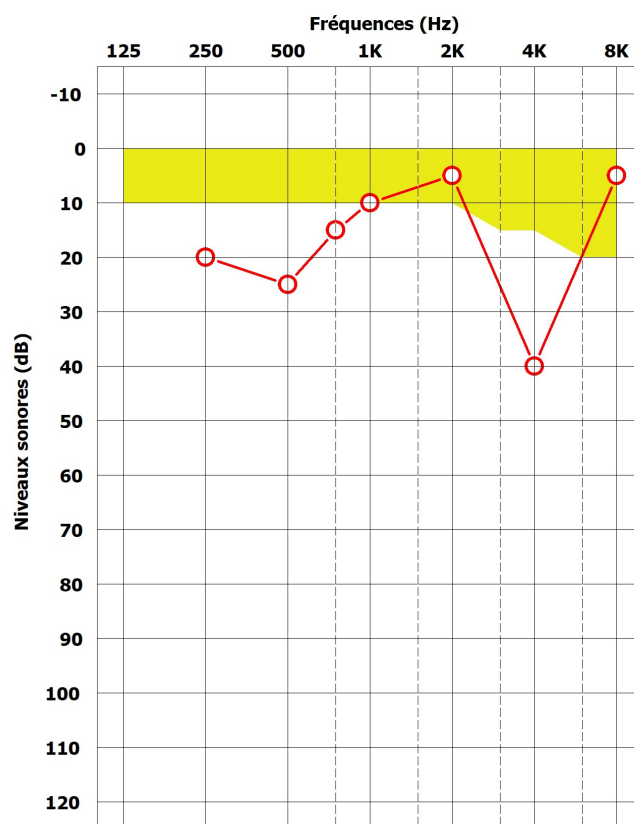

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	25		5		15		10
CA Droit		20	25	15	10		5		40		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes