



Données Patient		PENG BO
Date de naissance	25/10/1984	
Age	39	
Société	CR18	
ID	24050710195726506	

Date du test: 07/05/2024 10:21:18
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

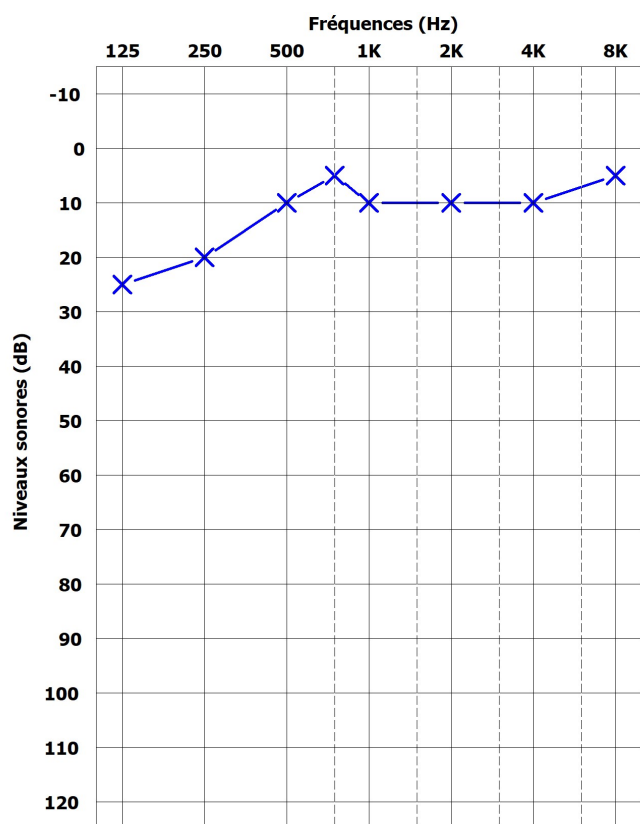

Oreille Gauche

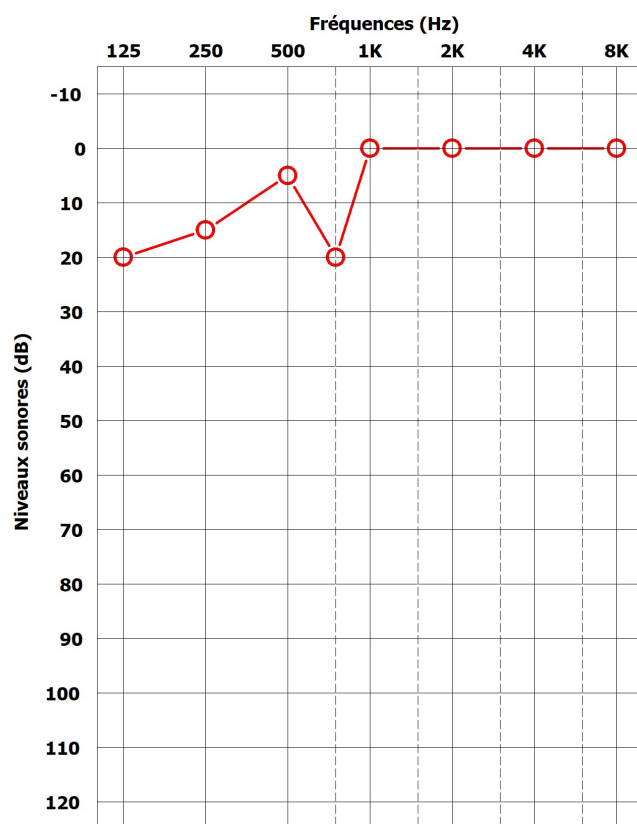

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	10	5	10		10		10		5
CA Droit	20	15	5	20	0		0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes