



Données Patient		KEÏTA KOULAKO
Date de naissance	11/05/2002	
Age	21	
Société	CR18	
ID	24050411124185101	

Date du test: 04/05/2024 11:17:02
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

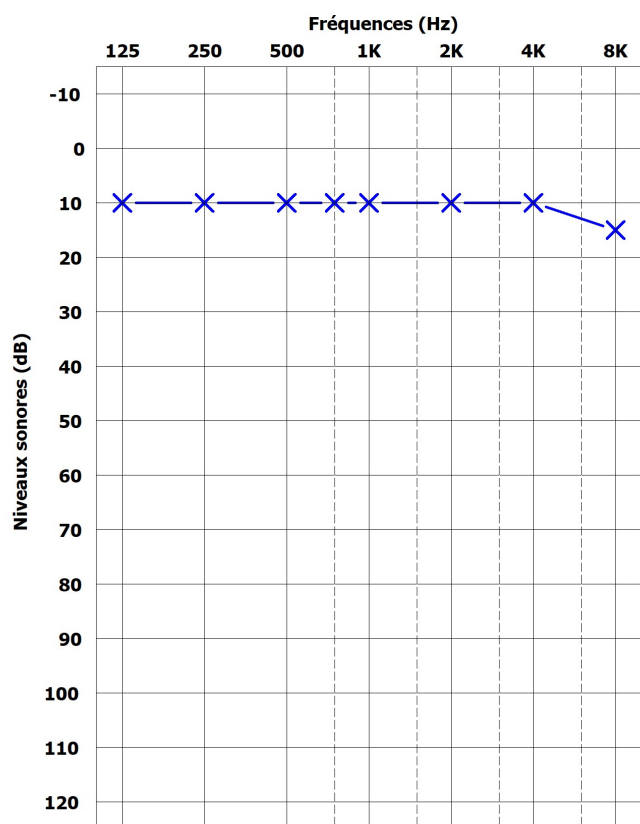

Oreille Gauche

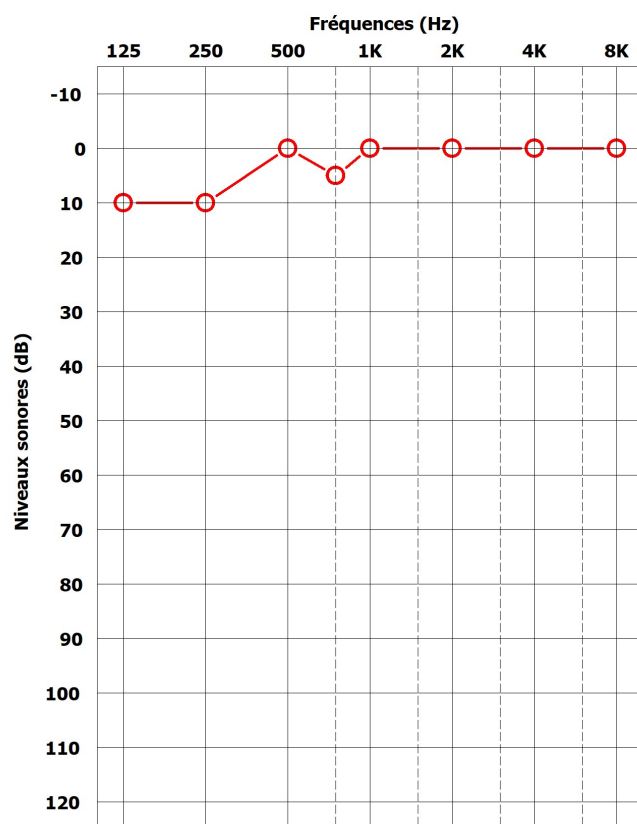

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	10	10	10	10		10		10		15
CA Droit	10	10	0	5	0		0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes