

MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 11:28:41

Durée: 4mn 19s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA SIDIKI	
Date de naissance	01/01/1985
Age	39
Société	CR18
ID	24093011253687755

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

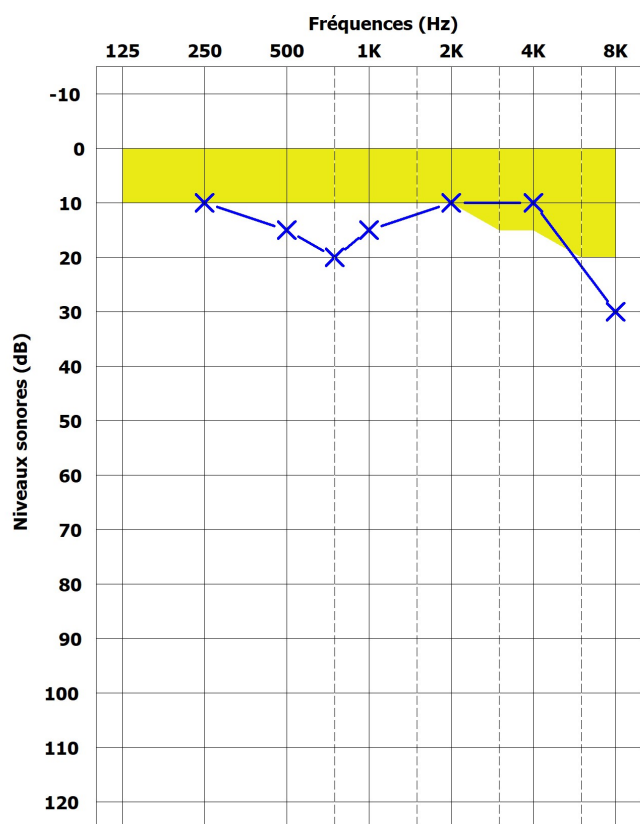

Oreille Gauche

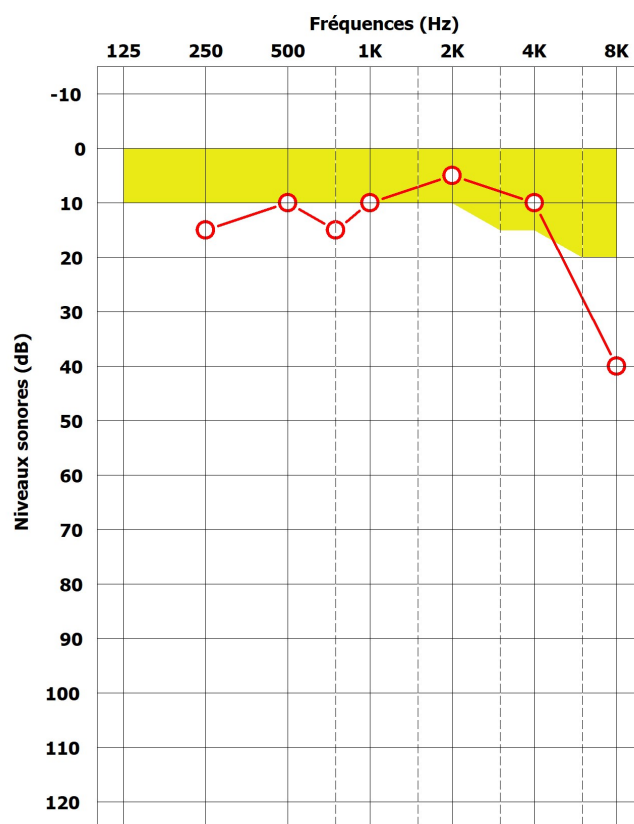

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	20	15		10		10		30
CA Droit		15	10	15	10		5		10		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes