


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 11:26:45

Durée: 4mn 10s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

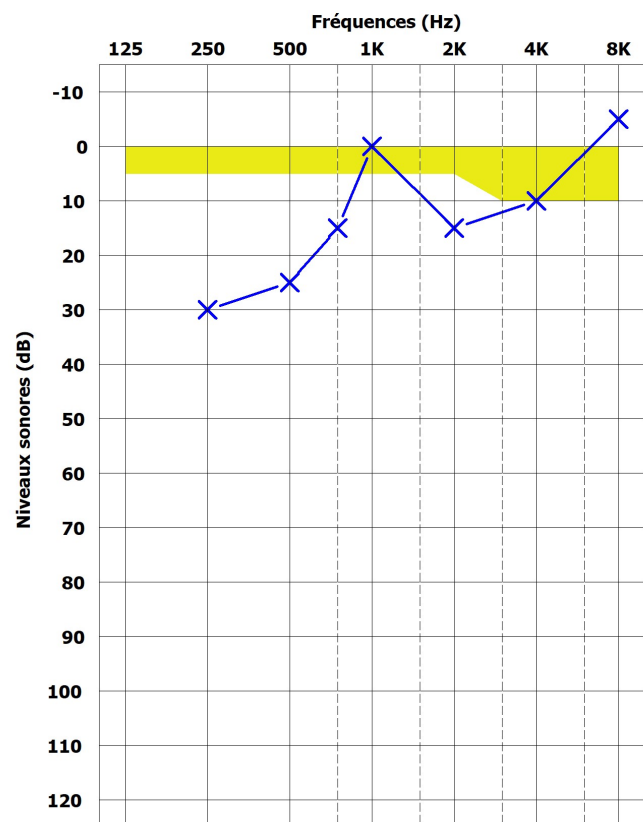

Oreille Gauche

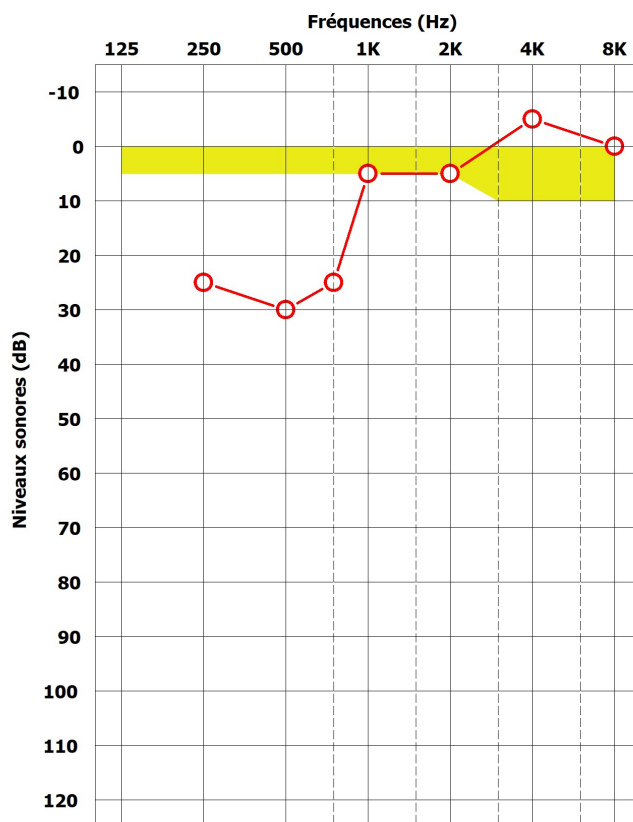

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	15	0		15		10		-5
CA Droit		25	30	25	5		5		-5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes

Données Patient	SANOH FASSOUMA
Date de naissance	27/08/2003
Age	21
Société	CR18
ID	25031411245986224

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021