



Données Patient		BAYO MAMADY
Date de naissance	01/01/2002	
Age	23	
Société	CR18	
ID	25010313371208707	

Date du test: 03/01/2025 13:40:40
Durée: 4mn 21s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

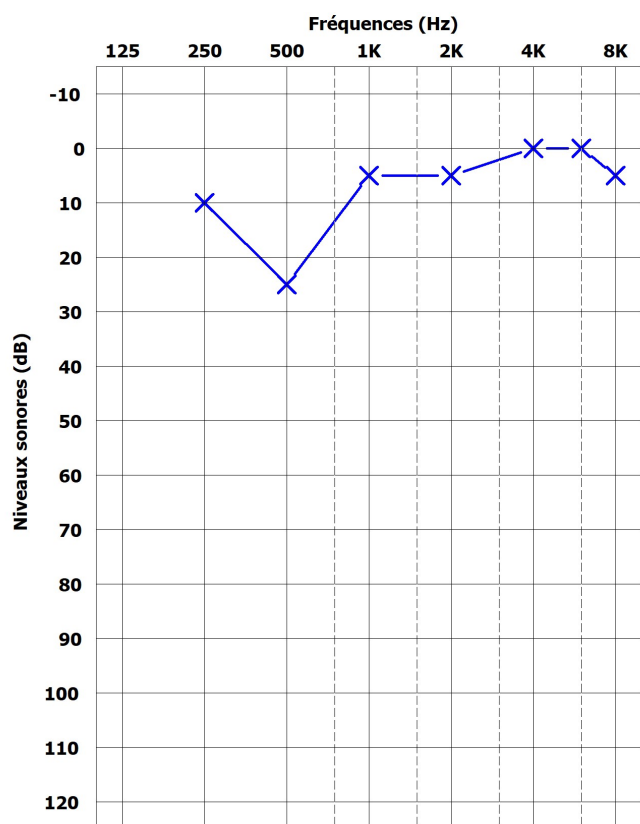

Oreille Gauche

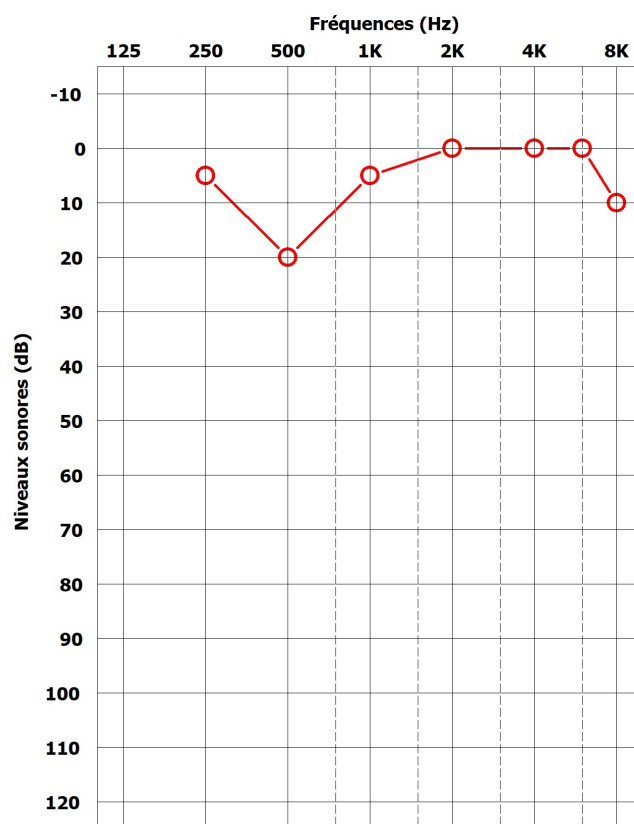

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25		5		5		0	0	5
CA Droit		5	20		5		0		0	0	10

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes