

MEDVIE

Date du test: 30/06/2025 18:59:50
Durée: 5mn 51s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

ZHONGQING MA

Date de naissance: 19/11/1975
Age: 49
Société: CR18
ID: 25063018551079333

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

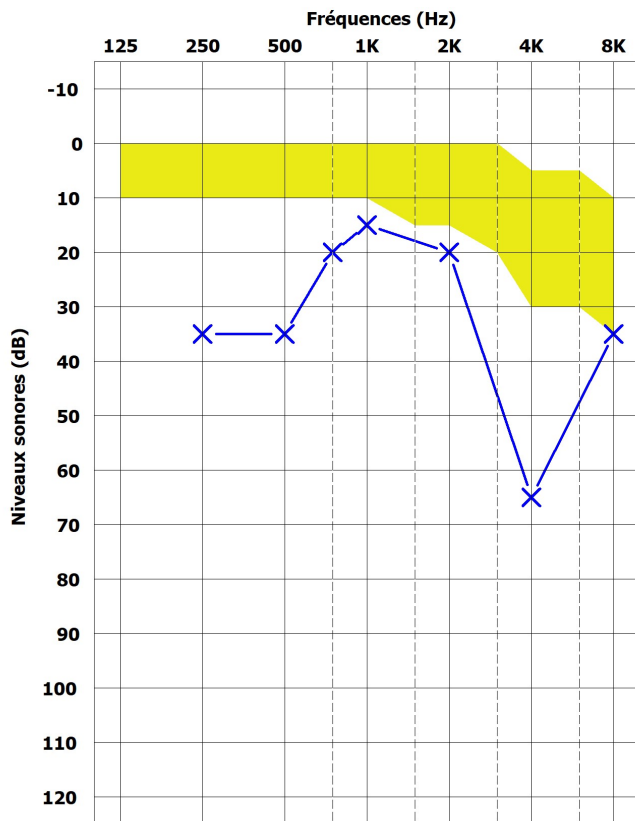

Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	35	20	15		20		65		35
CA Droit		35	35	30	15		25		70		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	33,8 dB	---
CA Droit	36,3 dB	---

Notes