

MEDVIE


Date du test: 07/03/2025 11:43:12

Durée: 3mn 42s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
NIAMY FRANCOIS	
Date de naissance	10/08/1984
Age	40
Société	CR18
ID	25030711401167582

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

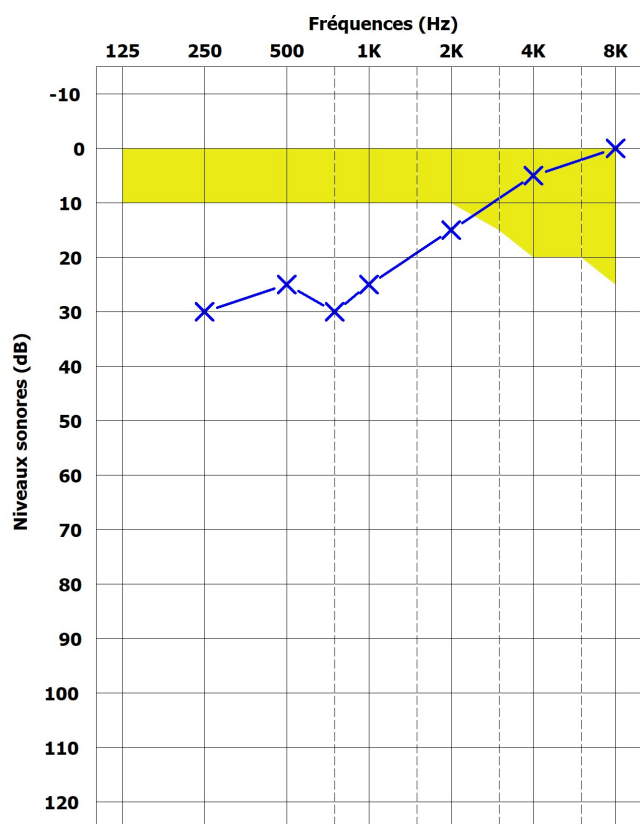

Oreille Gauche

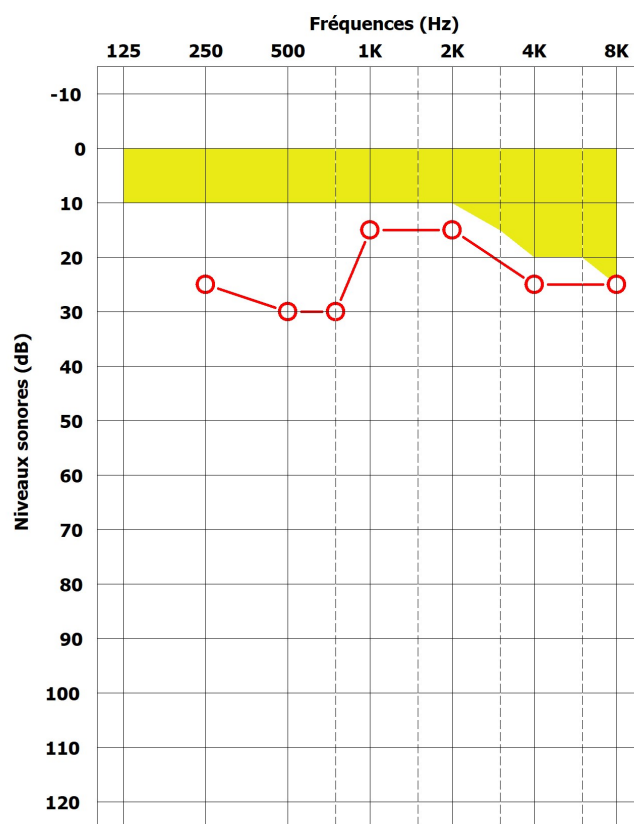

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	30	25		15		5		0
CA Droit		25	30	30	15		15		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes