

Données Patient

CONDE MOUSSA

Date de naissance 01/01/1998
Age 27
Société CR18
ID 25011513571305091


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021


Date du test: 15/01/2025 13:59:23

Durée: 5mn 45s

Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

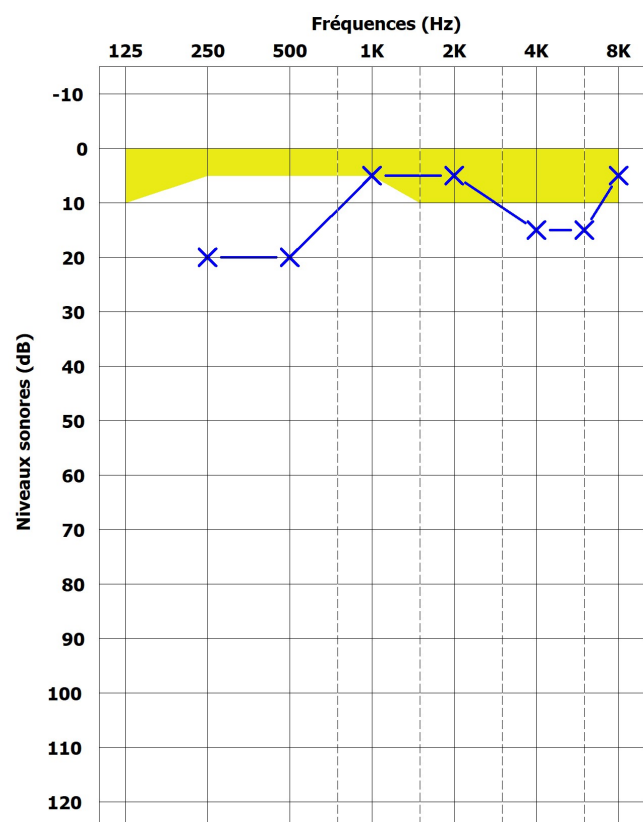

Oreille Gauche

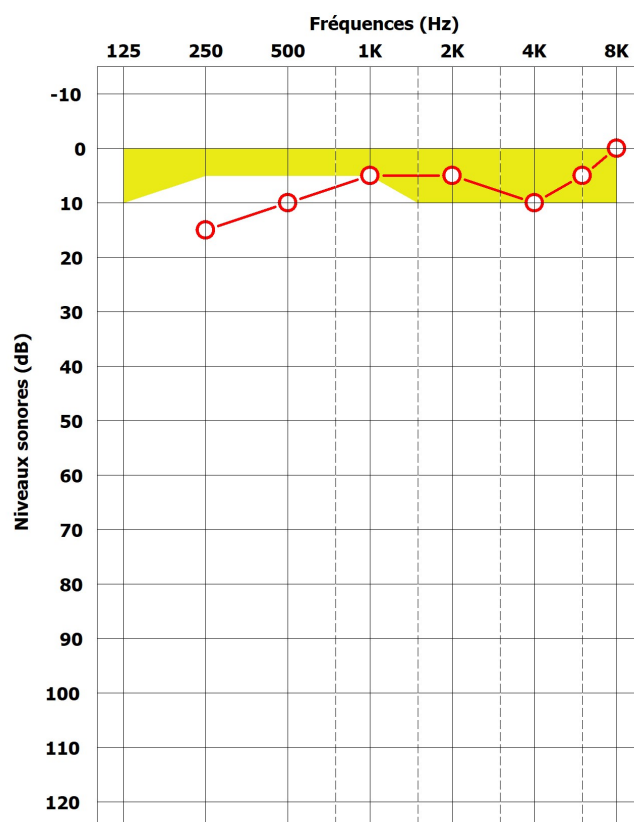

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20		5		5		15	15	5
CA Droit		15	10		5		5		10	5	0

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes