


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 14:10:53
Durée: 3mn 23s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA MATENIN	
Date de naissance	01/01/1987
Age	38
Société	CR18
ID	25031413563495324

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

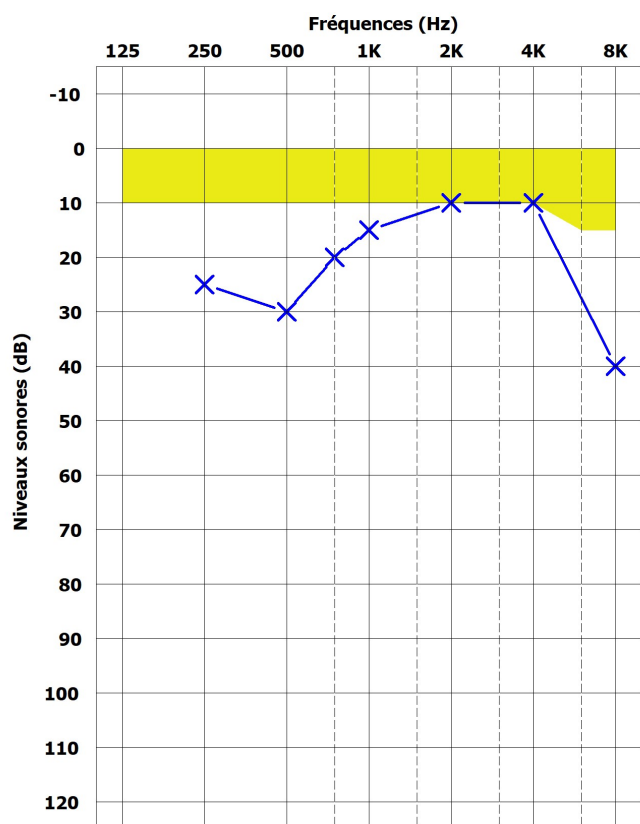

Oreille Gauche

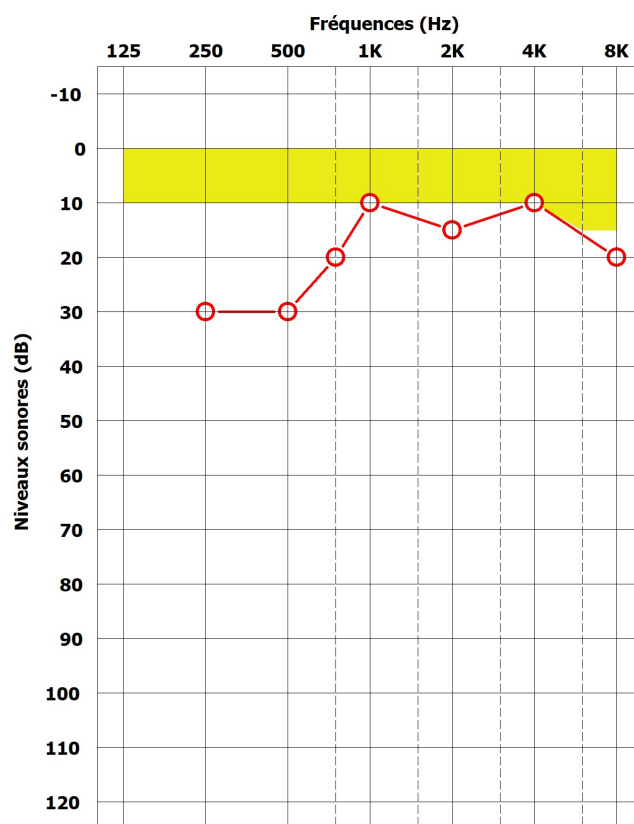

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	20	15		10		10		40
CA Droit		30	30	20	10		15		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes