


MEDVIE


Date du test: 07/03/2025 12:01:37
Durée: 4mn 49s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TRAORE FRESSOU	
Date de naissance	10/04/1990
Age	34
Société	CR18
ID	25030711565747580

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

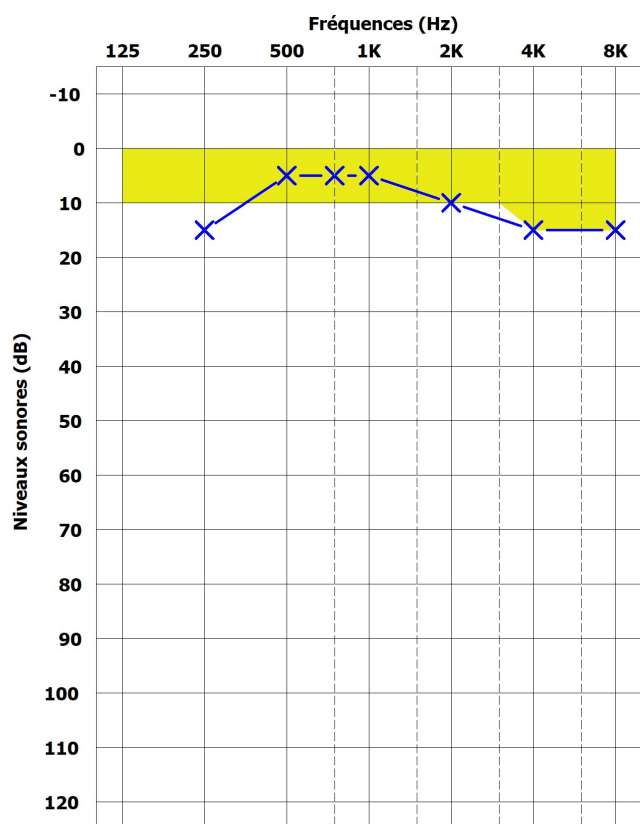

Oreille Gauche

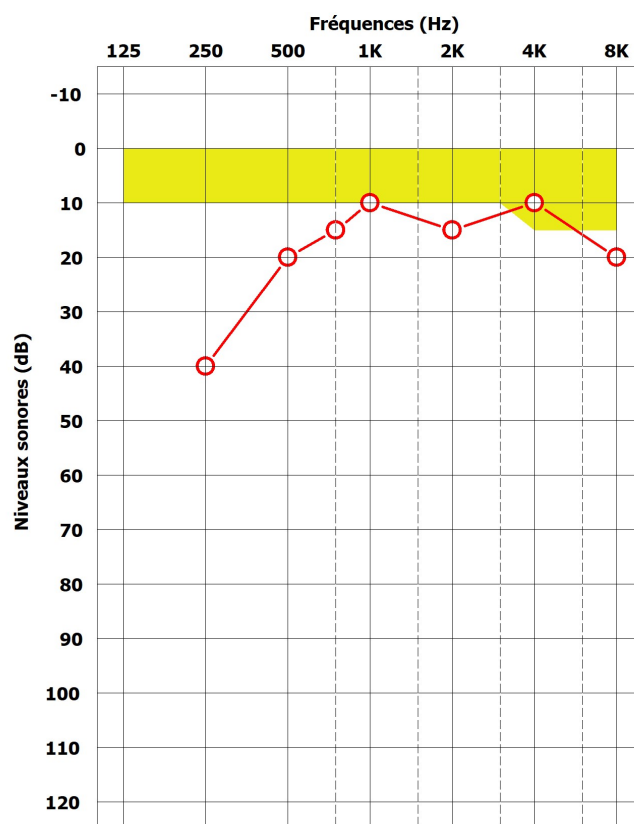

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	5	5	5		10		15		15
CA Droit		40	20	15	10		15		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes