


MEDVIE


Date du test: 17/05/2024 10:31:49  
Durée: -- mn -- s  
Type test Manuel  
Continu

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| CAMARA ADAMA      |                   |
| Date de naissance | 01/01/2003        |
| Age               | 21                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 24051710282336970 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

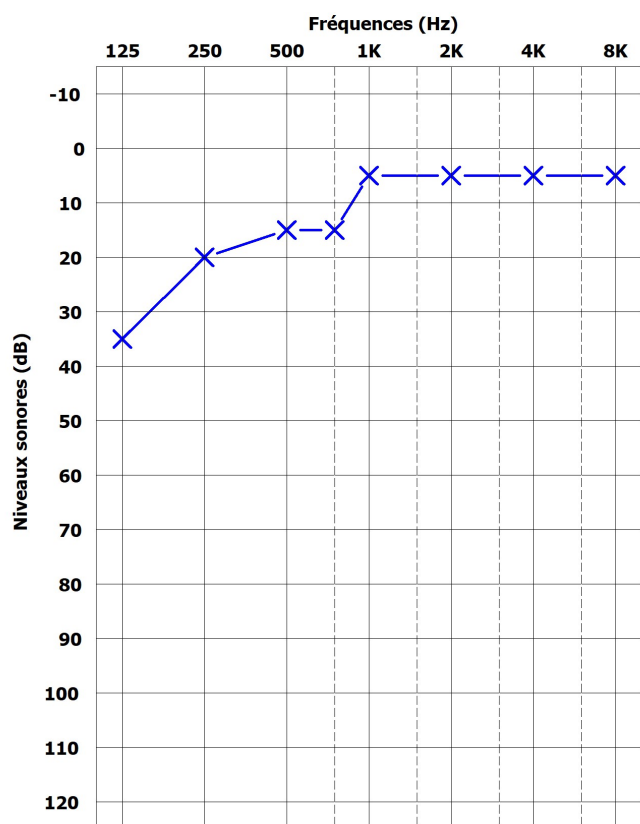

Oreille Gauche

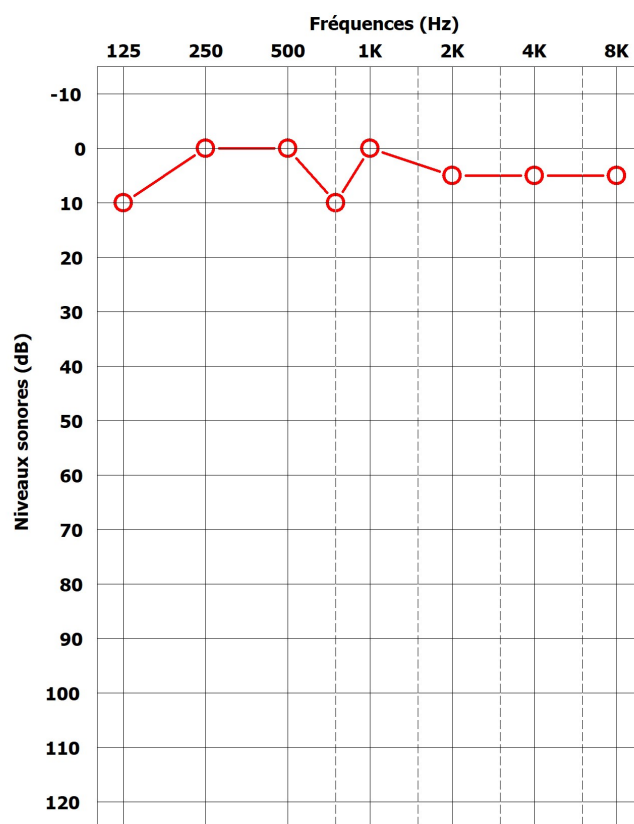

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 35  | 20  | 15  | 15  | 5  |     | 5  |    | 5  |    | 5  |
| CA Droit  | 10  | 0   | 0   | 10  | 0  |     | 5  |    | 5  |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 7,5 dB | --- |
| CA Droit        | 2,5 dB | --- |

Notes