


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 13:25:22
Durée: 4mn 18s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KEITA SAIDOU
Date de naissance	15/11/1989
Age	35
Société	CR18
ID	25031412490833603

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

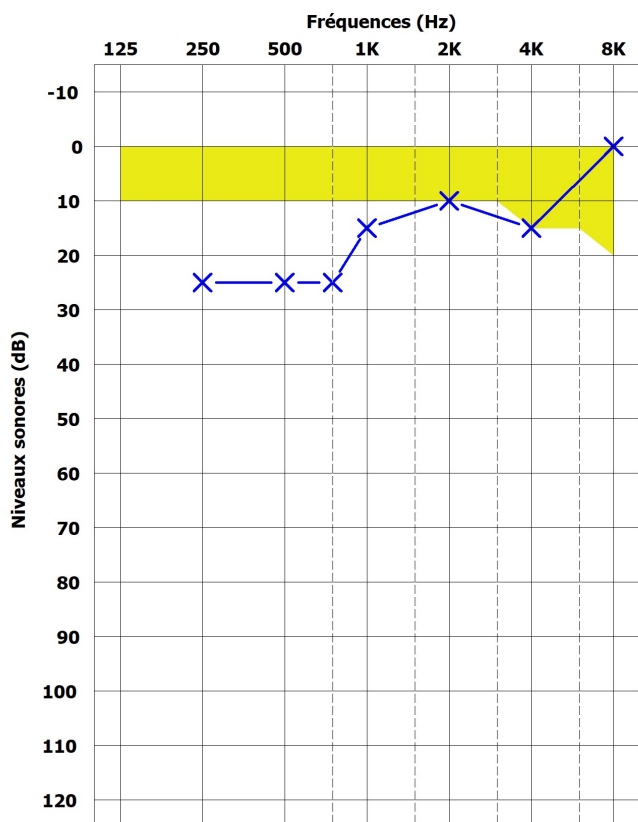

Oreille Gauche

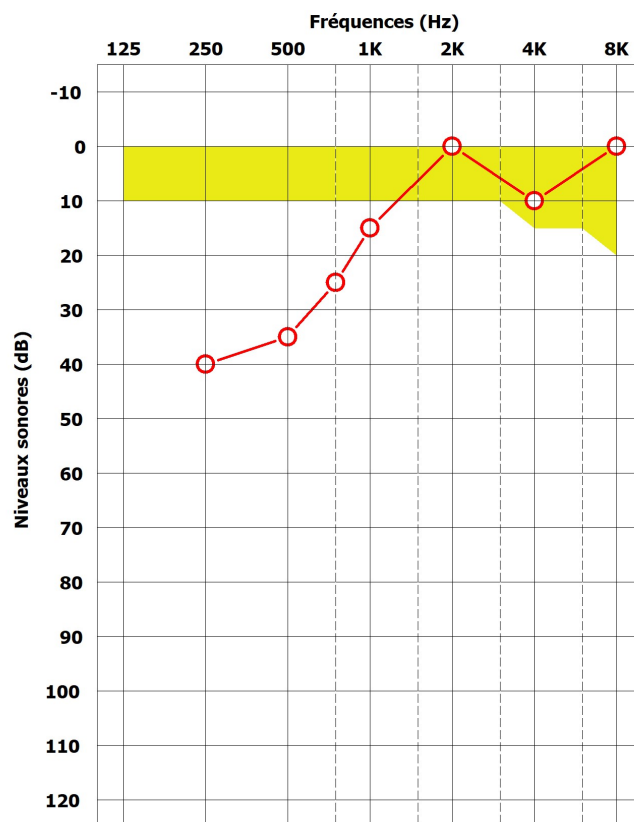

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	15		10		15		0
CA Droit		40	35	25	15		0		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes