

MEDVIE BEYLA


Date du test: 16/12/2024 13:53:49

Durée: 7mn 32s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KEITA MORY
Date de naissance	05/05/2004
Age	20
Société	CR18
ID	24121613435344745

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

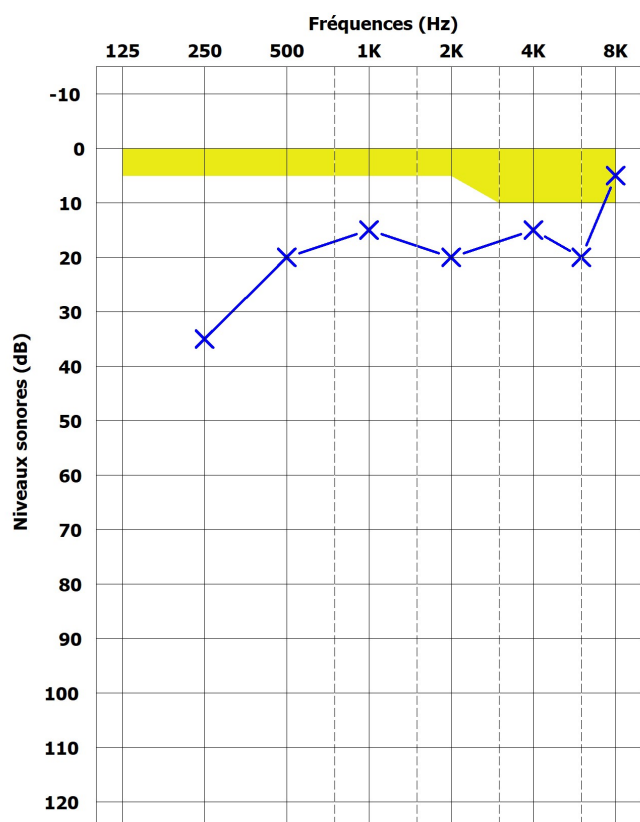

Oreille Gauche

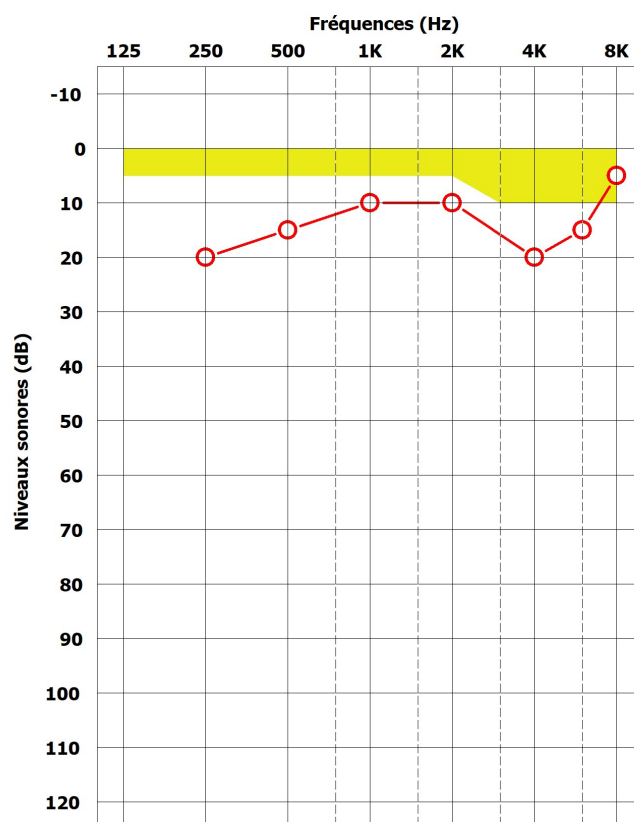

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	20		15		20		15	20	5
CA Droit		20	15		10		10		20	15	5

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes