

MEDVIE


Date du test: 07/03/2024 20:59:45

Durée: 8mn 00s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DABO SORY
Date de naissance	01/01/1999	
Age	25	
Société	CR18	
ID	24030720571393707	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

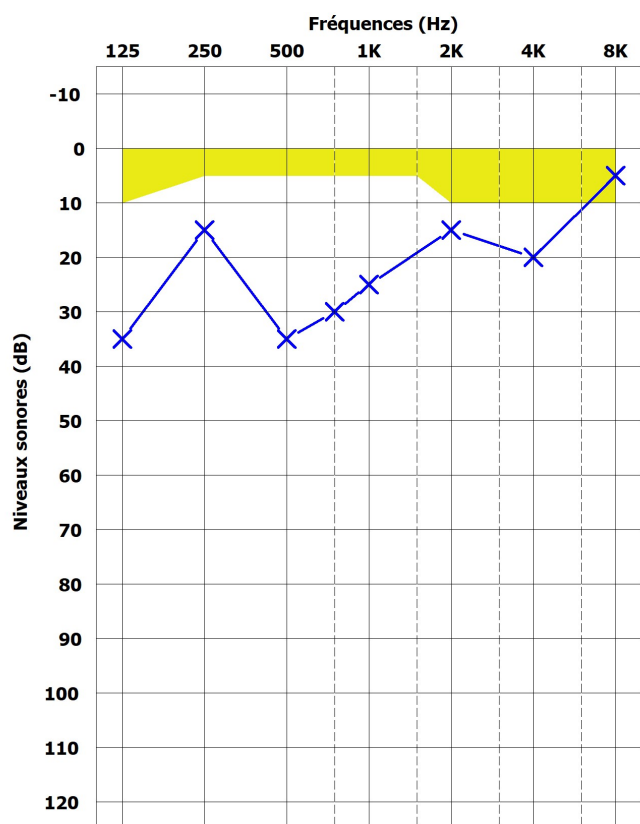

Oreille Gauche

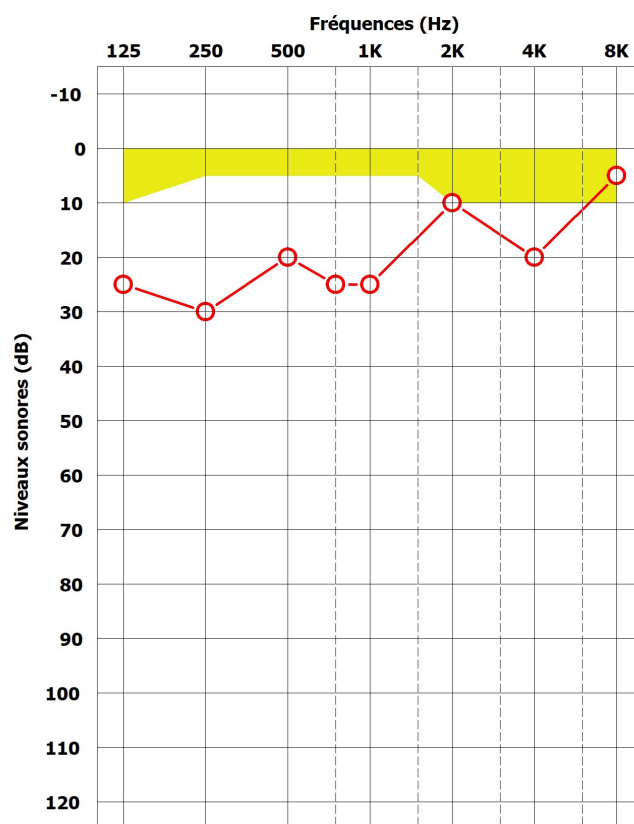

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	15	35	30	25		15		20		5
CA Droit	25	30	20	25	25		10		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes