


MEDVIE


Date du test: 10/03/2025 12:41:49
Durée: 4mn 50s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TOURE SEGA
Date de naissance	01/01/1984	
Age	41	
Société	CR18	
ID	25031012335937391	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

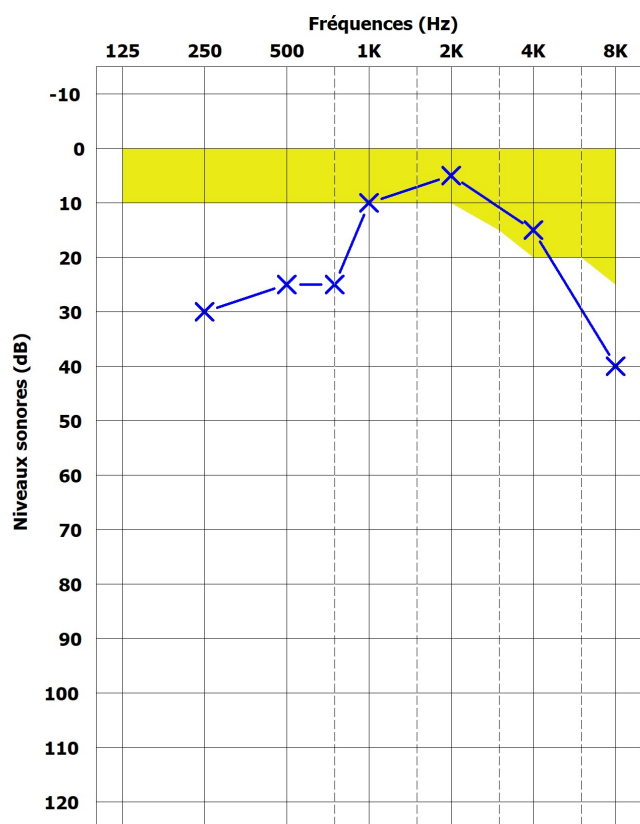

Oreille Gauche

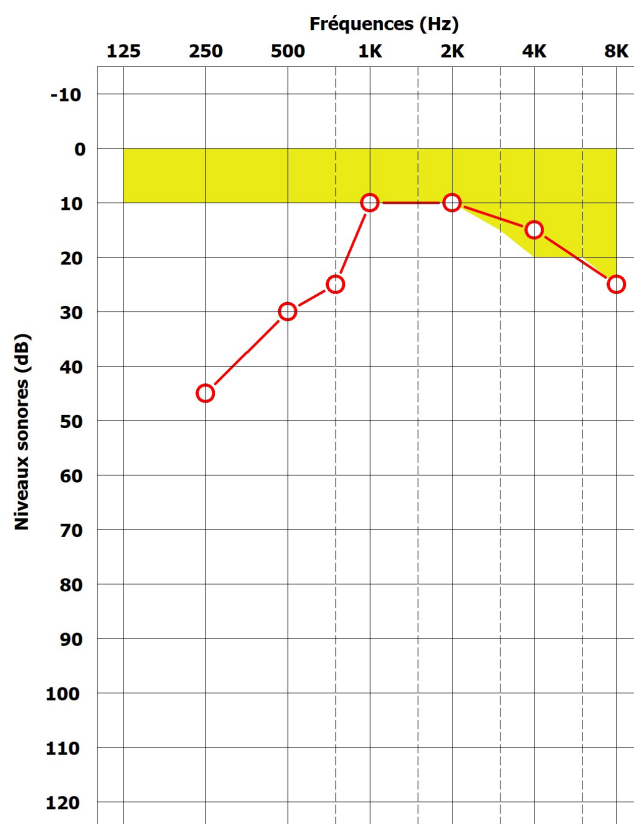

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	10		5		15		40
CA Droit		45	30	25	10		10		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes