

MEDVIE


Date du test: 11/03/2025 11:37:32

Durée: 5mn 49s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KONATE MORY
Date de naissance	24/03/1992
Age	32
Société	CR18
ID	25031111325333356

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

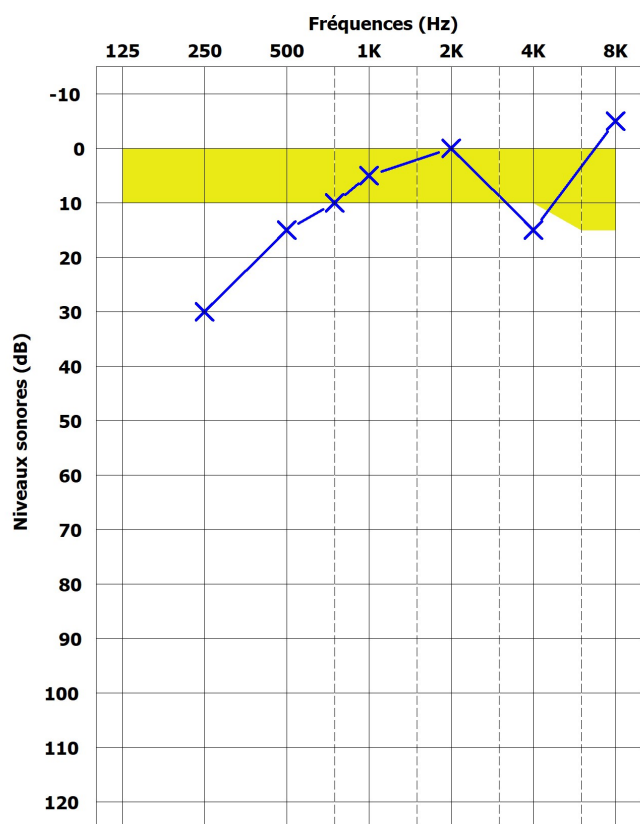

Oreille Gauche

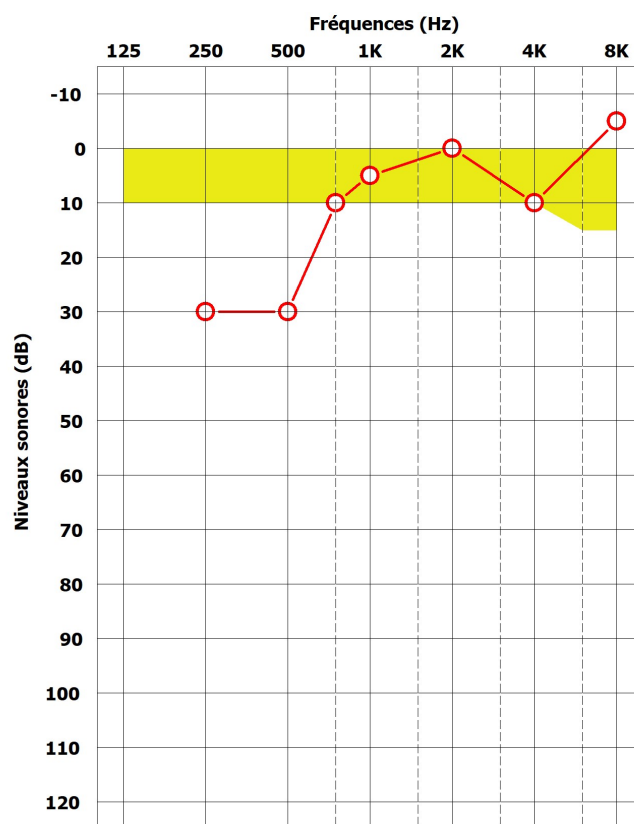

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	15	10	5		0		15		-5
CA Droit		30	30	10	5		0		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes