


MEDVIE


Date du test: 14/05/2024 12:00:33
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		CONDE MORY
Date de naissance	01/01/1992	
Age	32	
Société	CR18	
ID	24051411563371769	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

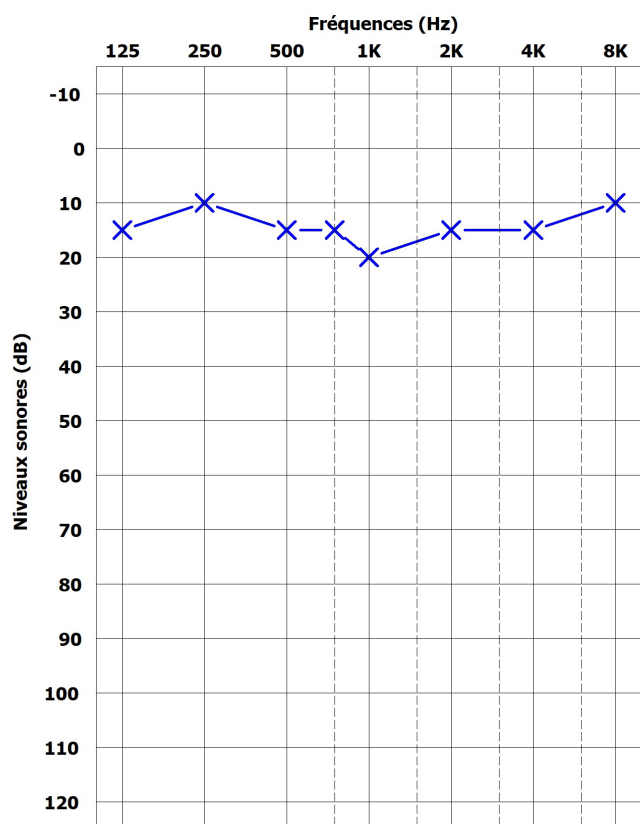

Oreille Gauche

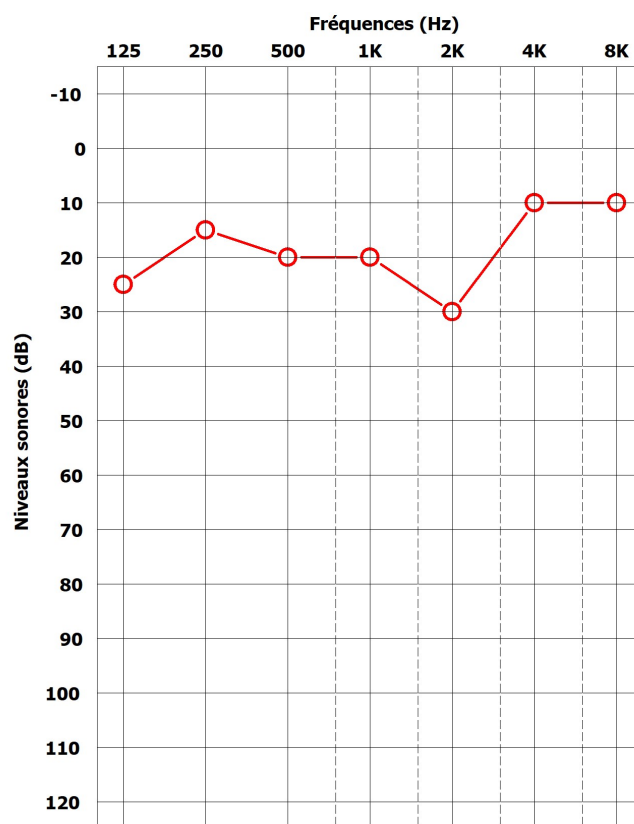

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	15	15	20		15		15		10
CA Droit	25	15	20		20		30		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes