

MEDVIE


Date du test: 09/04/2024 17:12:54

Durée: 15mn 22s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TRAORE FASSOU
Date de naissance	01/01/1977	
Age	47	
Société	CR18	
ID	24040917111412665	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

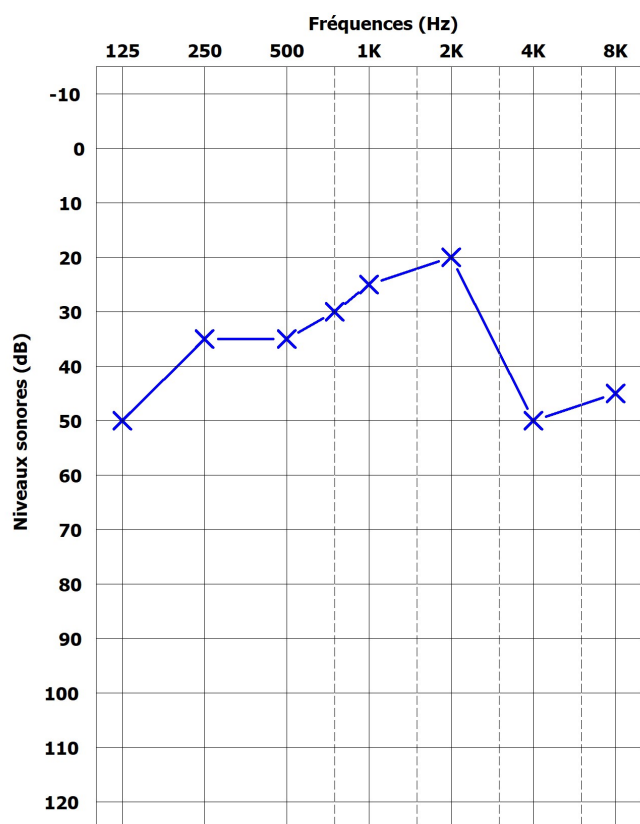

Oreille Gauche

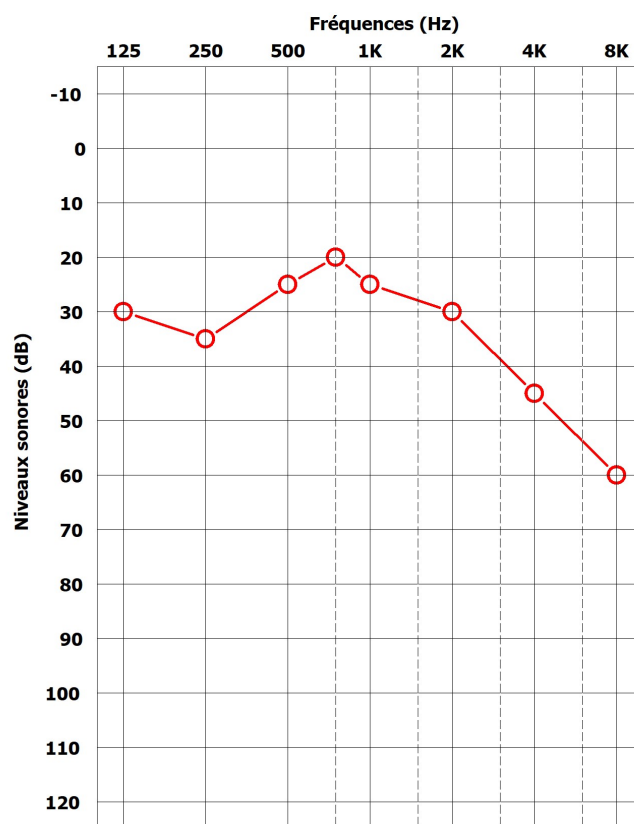

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	50	35	35	30	25		20		50		45
CA Droit	30	35	25	20	25		30		45		60

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	32,5 dB	---
CA Droit	31,3 dB	---

Notes