


MEDVIE


Date du test: 05/03/2025 15:28:11
Durée: 3mn 25s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
DOUMBOUYA MUHAMED	
Date de naissance	01/01/1999
Age	26
Société	CR18
ID	25030515000632223

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

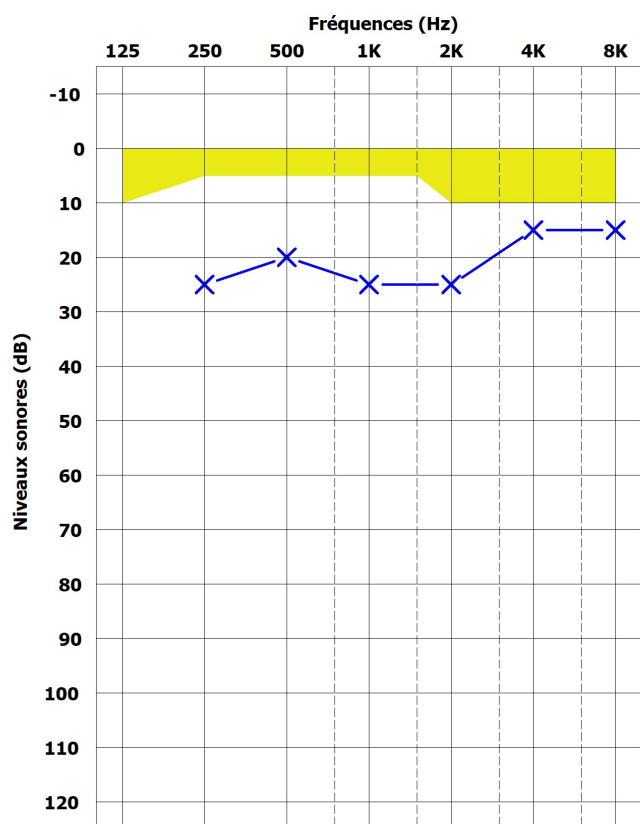

Oreille Gauche

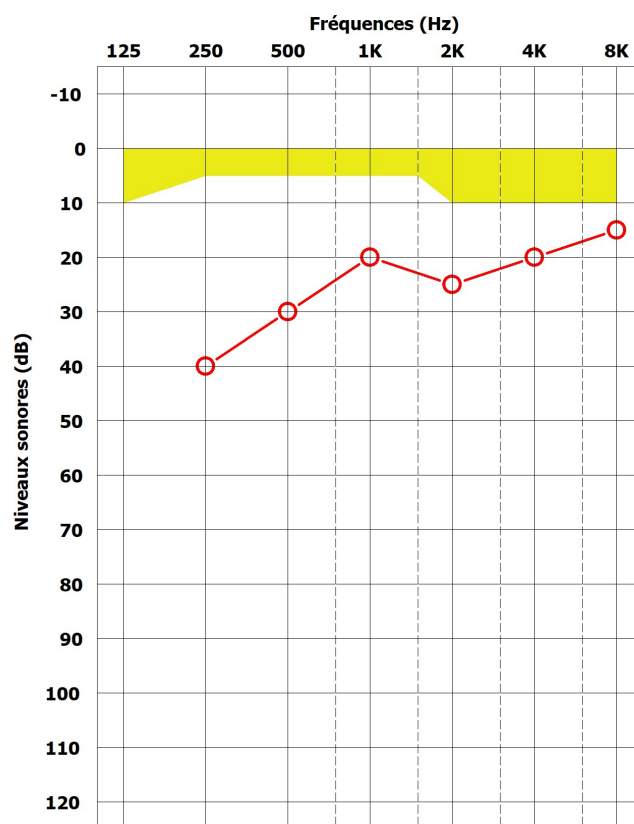

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20		25		25		15		15
CA Droit		40	30		20		25		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes