

MEDVIE


Date du test: 17/04/2024 14:15:02

Durée: 9mn 28s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		KEÏTA BAKARY
Date de naissance	02/03/1998	
Age	26	
Société	CR18	
ID	24041714124495452	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

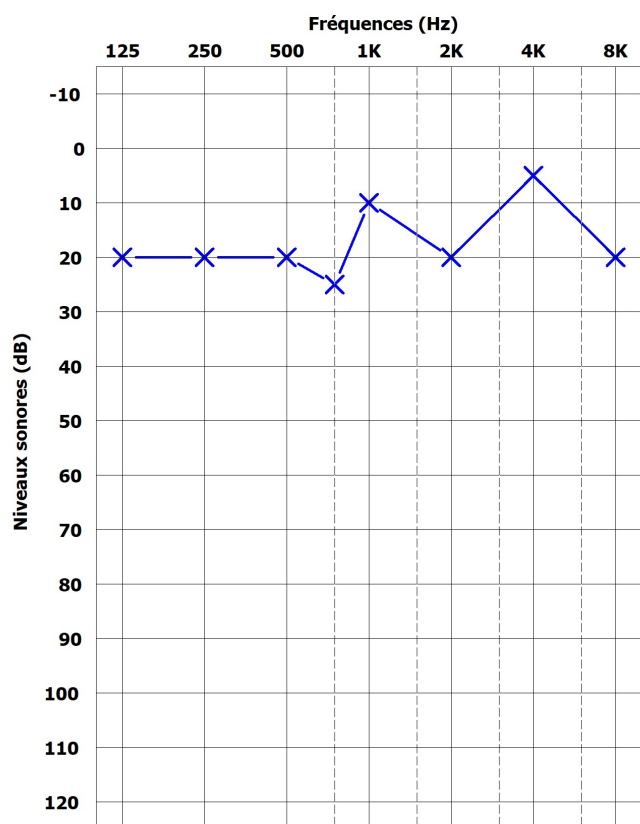

Oreille Gauche

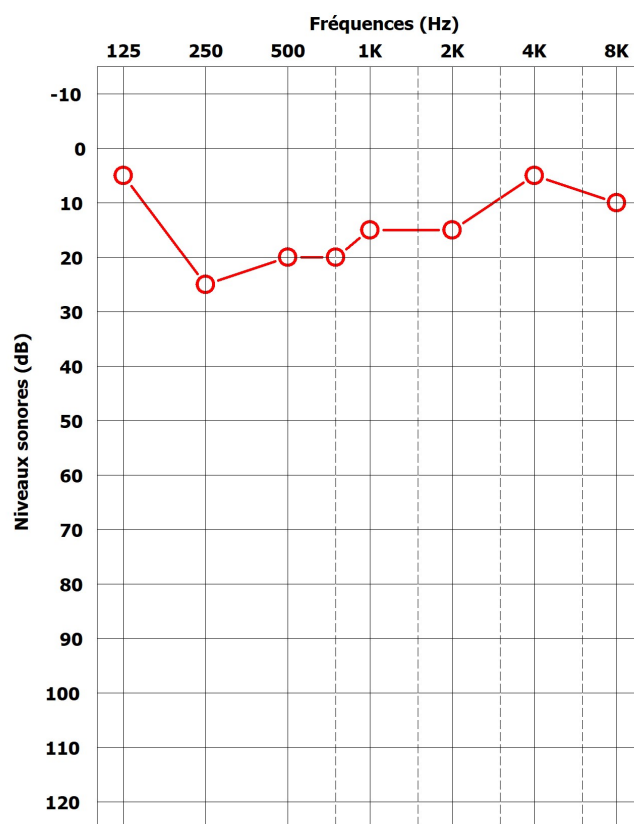

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	25	10		20		5		20
CA Droit	5	25	20	20	15		15		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes