

Données Patient


CONDE MOHAMED

Date de naissance 01/01/2003
Age 21
Société CR18
ID 24050809263960320


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 08/05/2024 09:28:07
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

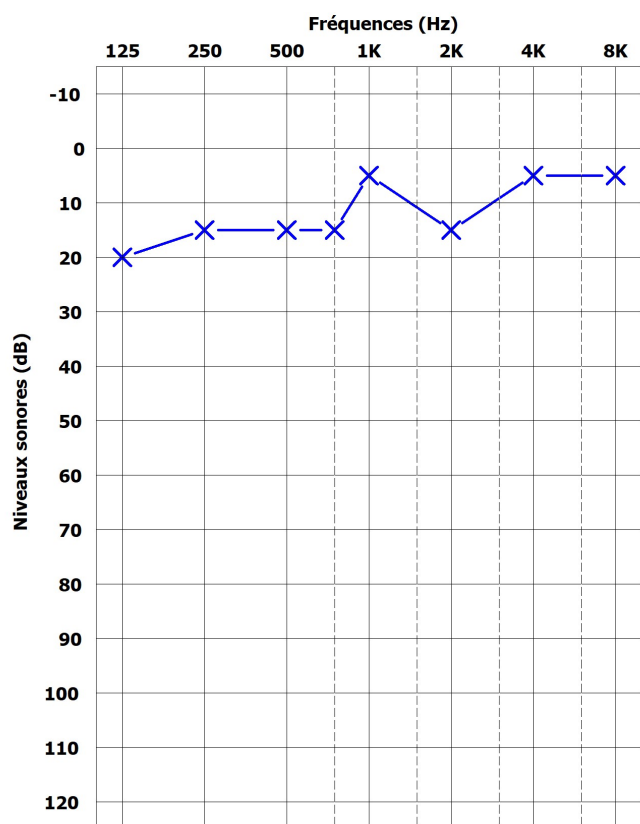

Oreille Gauche

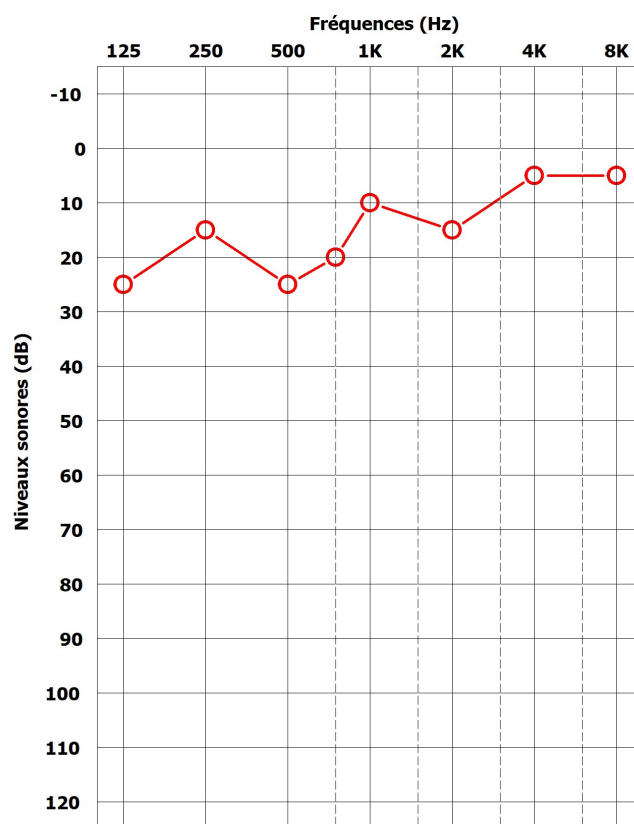

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	15	5		15		5		5
CA Droit	25	15	25	20	10		15		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes