


MEDVIE


Date du test: 10/12/2024 12:42:43

Durée: 6mn 35s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

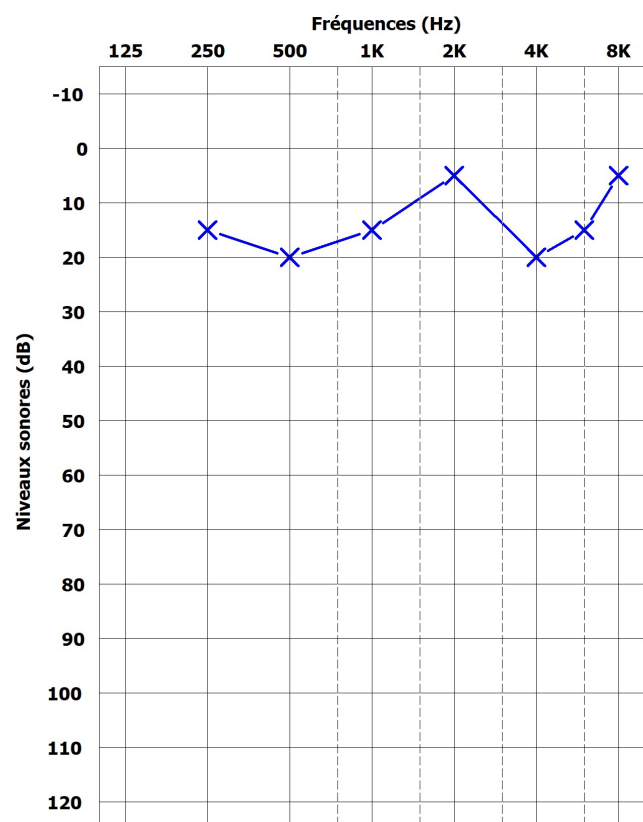

Oreille Gauche

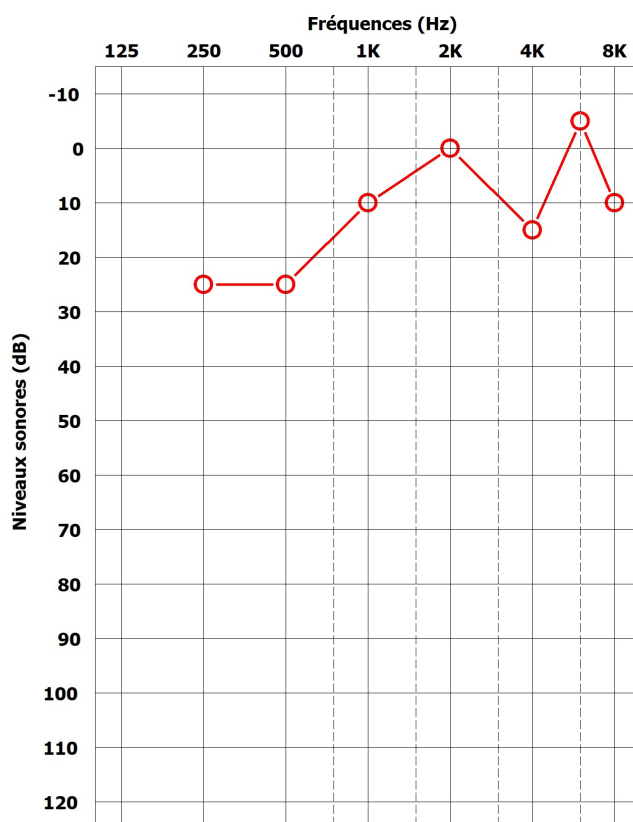

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20		15		5		20	15	5
CA Droit		25	25		10		0		15	-5	10

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes

Données Patient	KANTE MAMADY
Date de naissance	29/05/1992
Age	32
Société	CR18
ID	24121012403542065

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021