


MEDVIE


Date du test: 14/05/2024 10:56:53
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	CONDE MOHAMED
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CR18
ID	24051410514544967

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

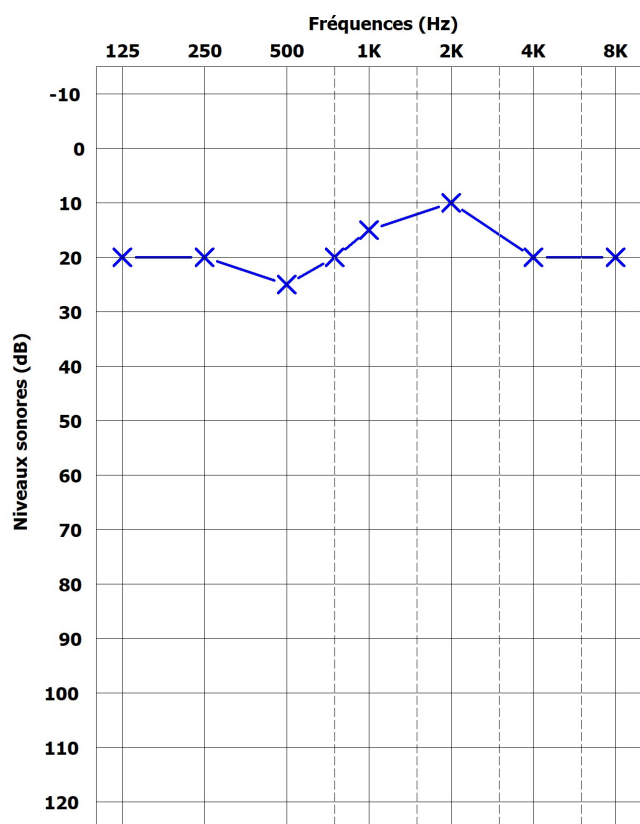

Oreille Gauche

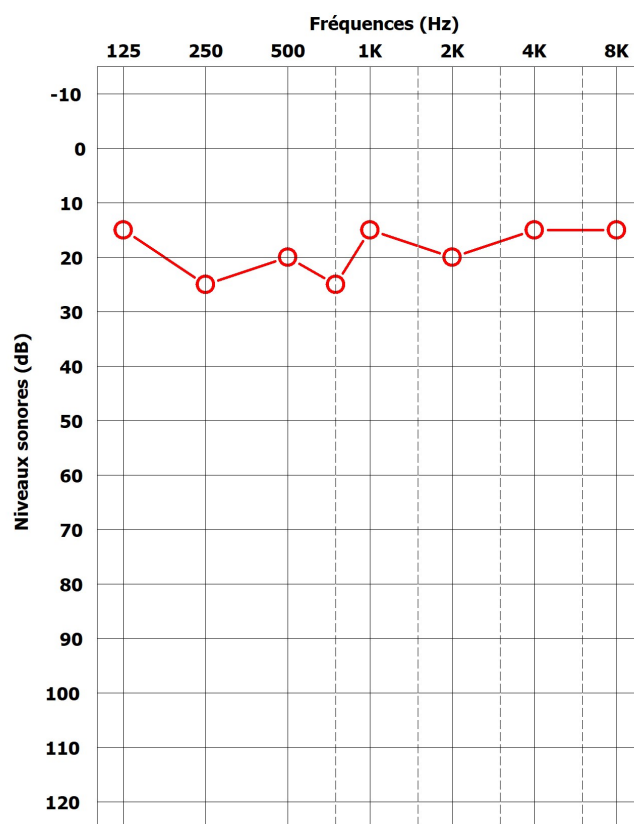

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	25	20	15		10		20		20
CA Droit	15	25	20	25	15		20		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes