

MEDVIE


Date du test: 29/03/2024 16:44:17

Durée: 5mn 15s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA KARIM	
Date de naissance	01/01/1979
Age	45
Société	CR18
ID	24032916411790435

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

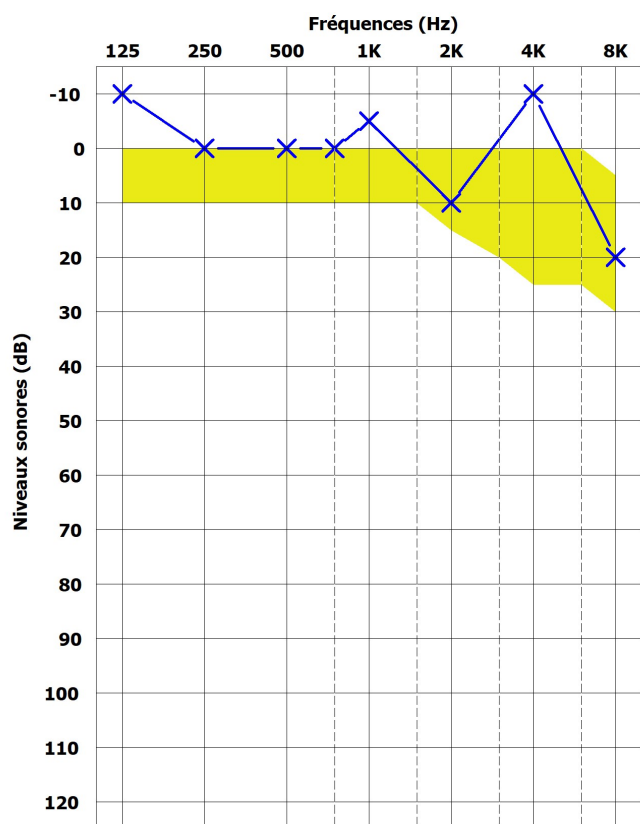

Oreille Gauche

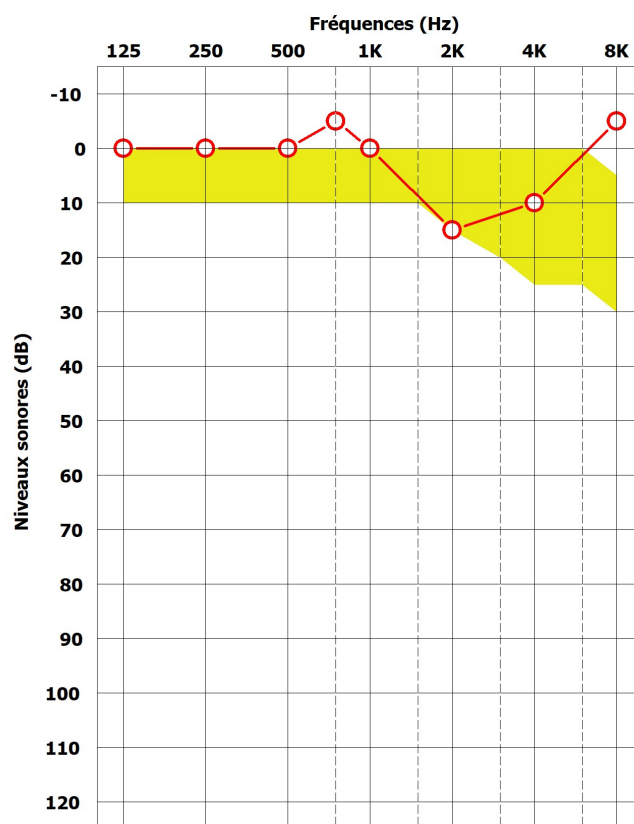

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	-10	0	0	0	-5		10		-10		20
CA Droit	0	0	0	-5	0		15		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-1,3 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes