

MEDVIE

Date du test: 25/05/2024 14:00:42


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel


Continu

Données Patient		TRAORE SOKO
Date de naissance		01/01/1989
Age		35
Société		CR18
ID		24052513590518807

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

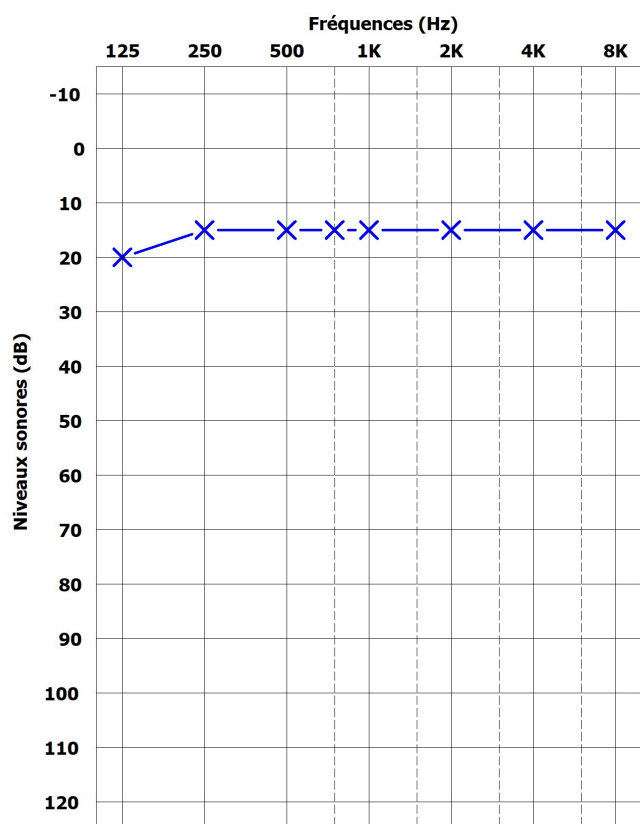

Oreille Gauche

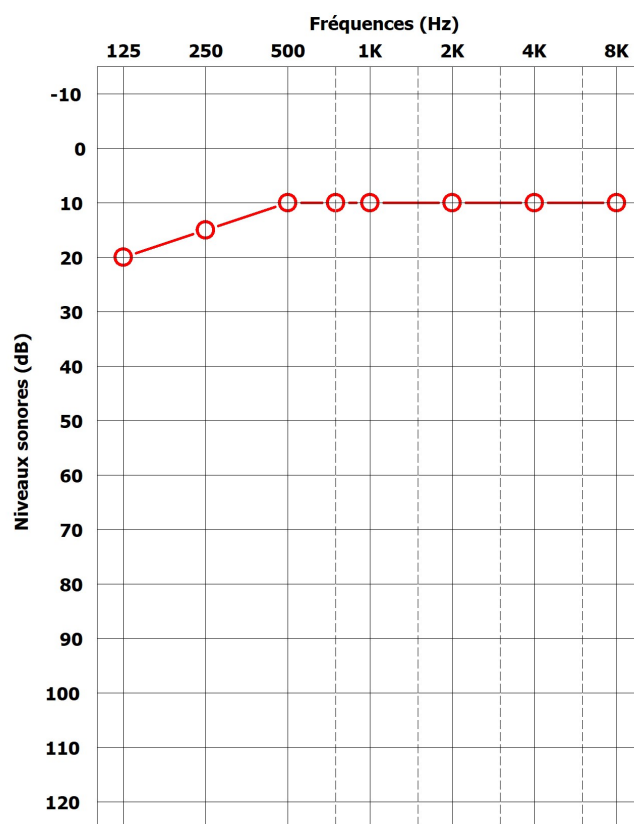

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	15	15		15		15		15
CA Droit	20	15	10	10	10		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes