

MEDVIE

Date du test: 24/05/2024 10:45:08


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel


Continu

Données Patient		SAGNO SEKOU
Date de naissance	01/01/1984	
Age	40	
Société	CR18	
ID	24052410411687043	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

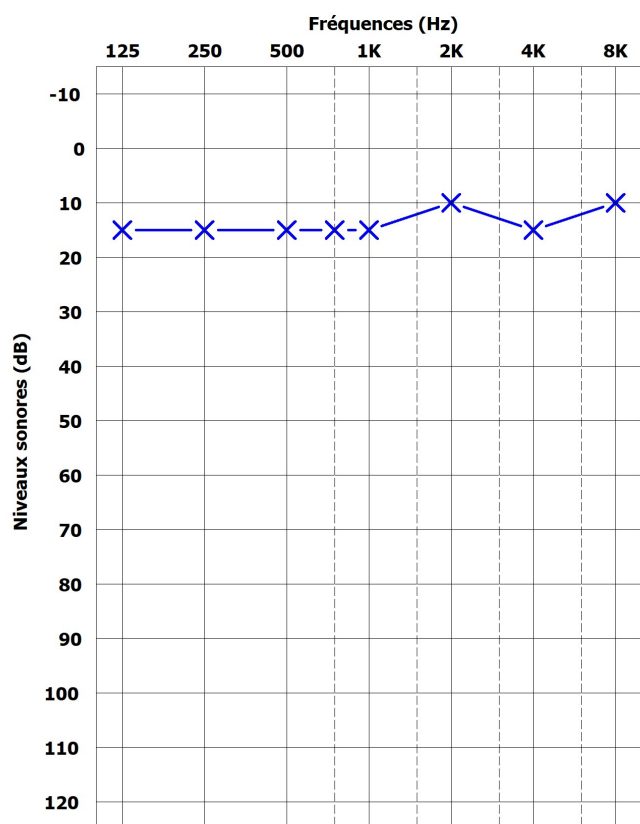

Oreille Gauche

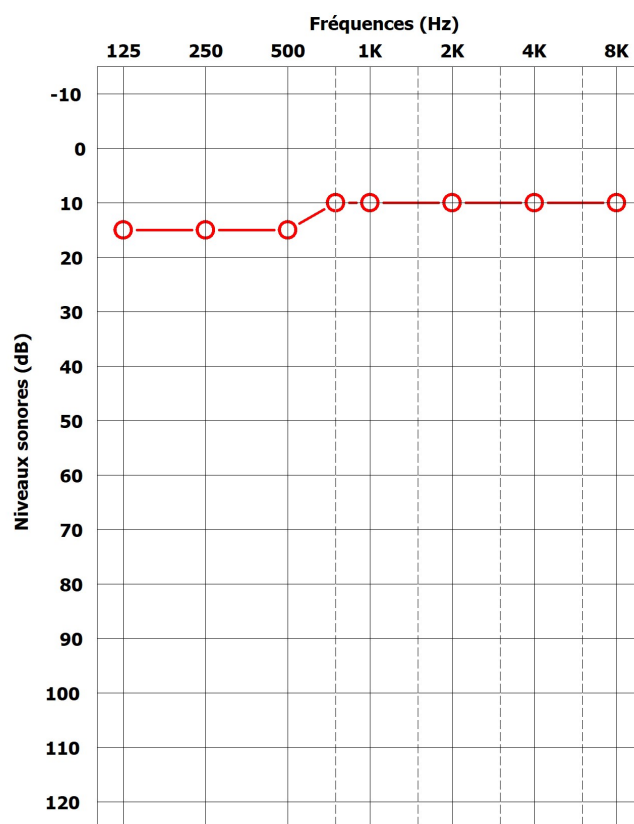

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	15	15	15		10		15		10
CA Droit	15	15	15	10	10		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes