

MEDVIE

Date du test: 01/06/2024 14:00:07


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel


Continu

Données Patient	SOUMAORO SIDIKI
Date de naissance	13/07/1993
Age	30
Société	CR18
ID	24060113563364231

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

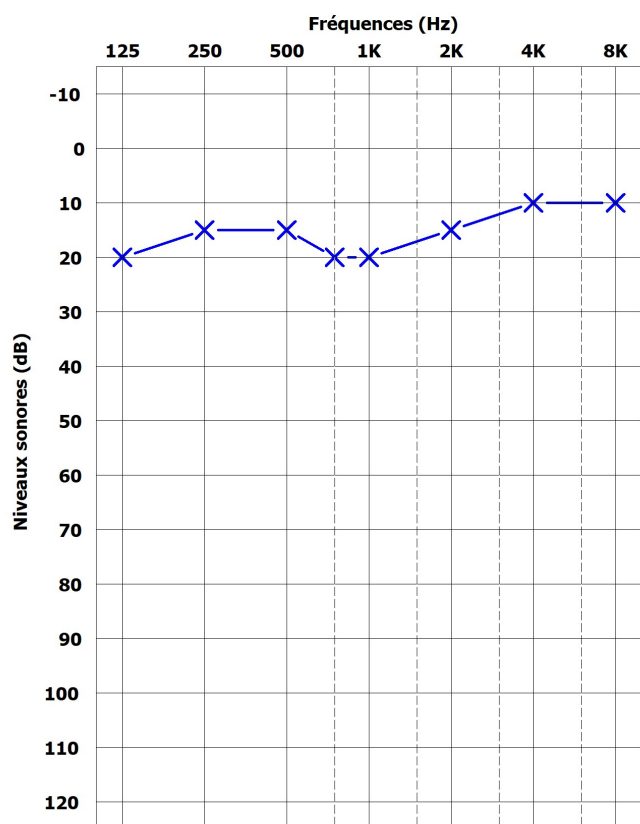

Oreille Gauche

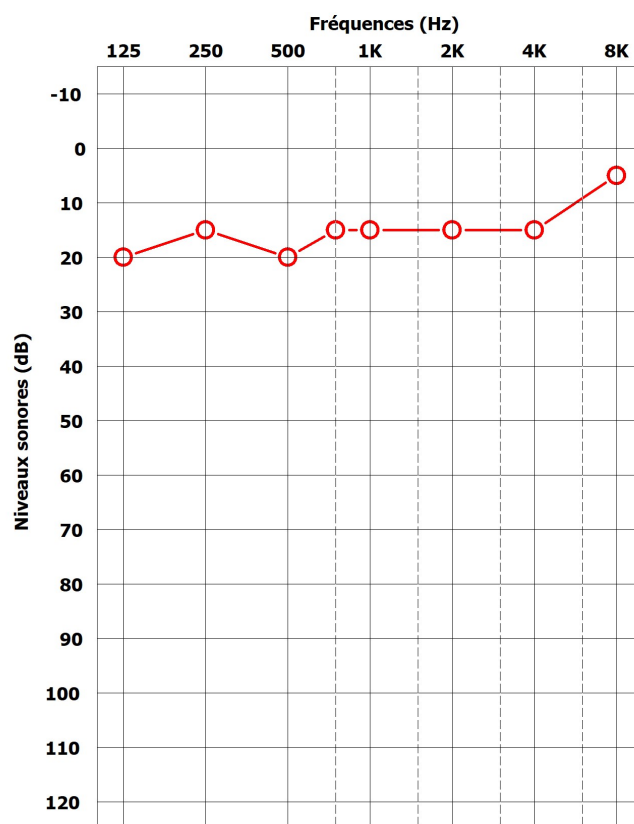

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	20	20		15		10		10
CA Droit	20	15	20	15	15		15		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes