

MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 16:35:33

Durée: 11mn 35s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SAMOURA MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1986
Age	38
Société	CR18
ID	24041516305307915

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

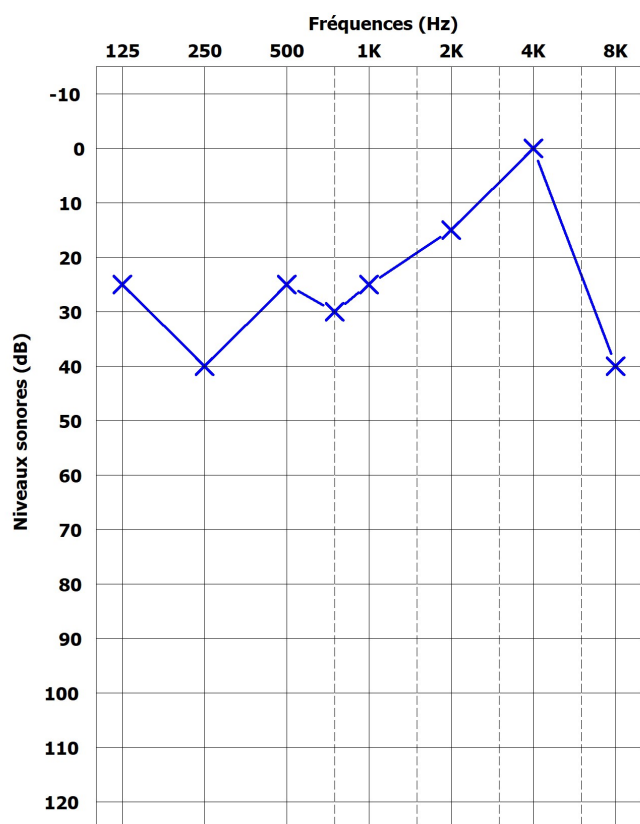

Oreille Gauche

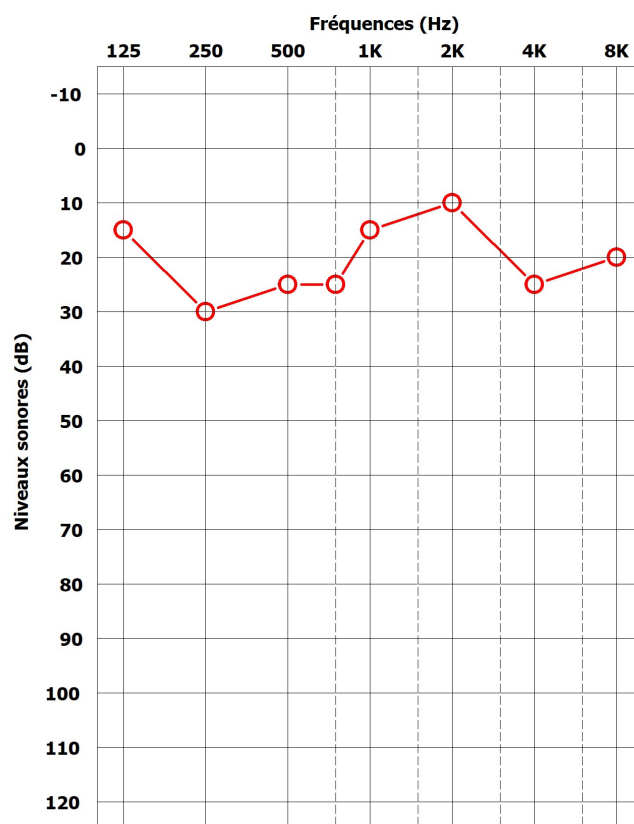

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	40	25	30	25		15		0		40
CA Droit	15	30	25	25	15		10		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes