


MEDVIE


Date du test: 29/02/2024 13:36:35
Durée: 7mn 46s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CISSE SEKOU
Date de naissance	01/01/1996	
Age	28	
Société	CR18	
ID	24022913323194069	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

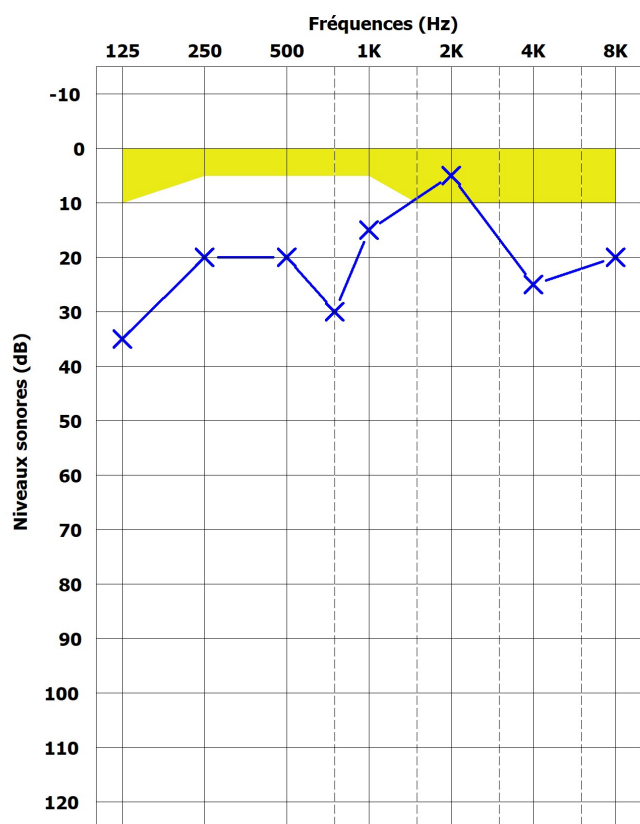

Oreille Gauche

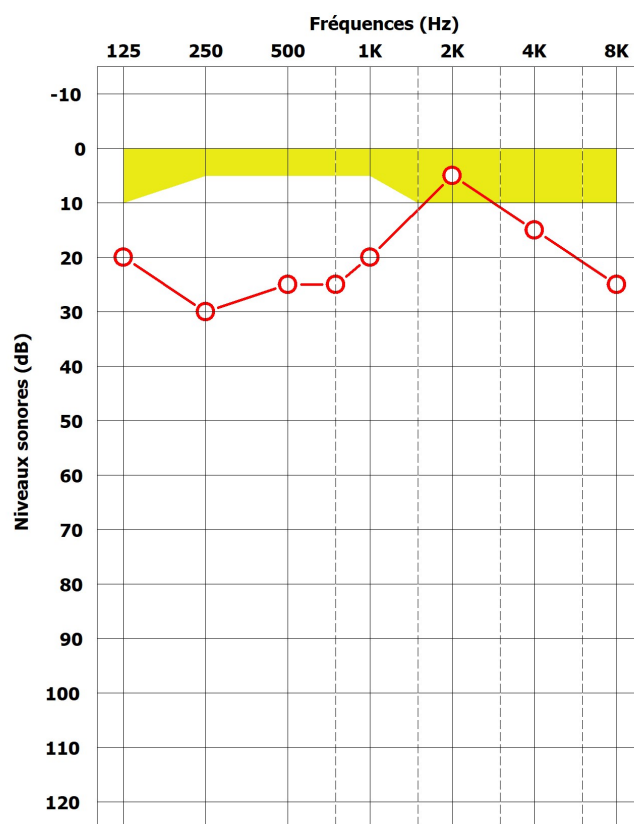

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	20	20	30	15		5		25		20
CA Droit	20	30	25	25	20		5		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes