



Données Patient		KOUROUMA ZOUMANA
Date de naissance	01/01/1984	
Age	40	
Société	CR18	
ID	24102313124661268	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

Date du test: 23/10/2024 13:16:29  
 Durée: 4mn 39s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

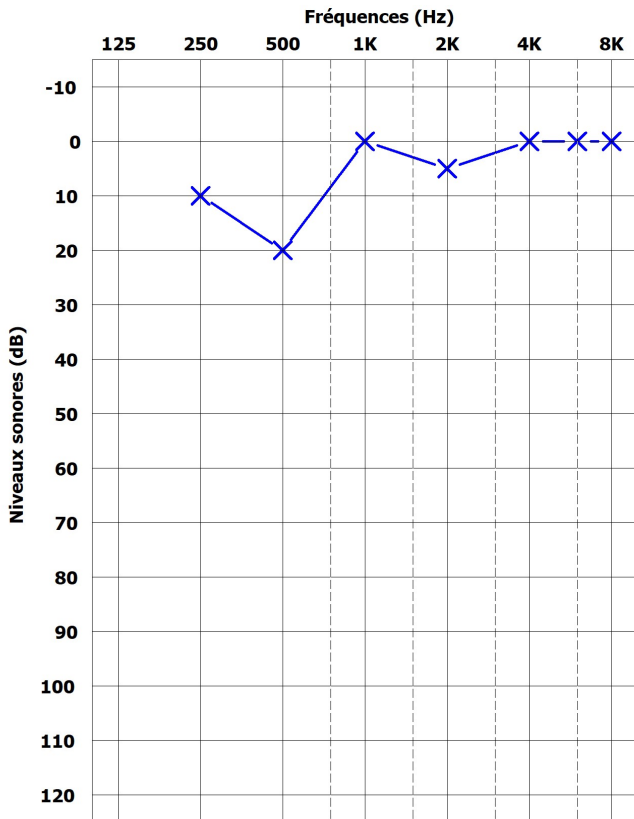

Oreille Gauche

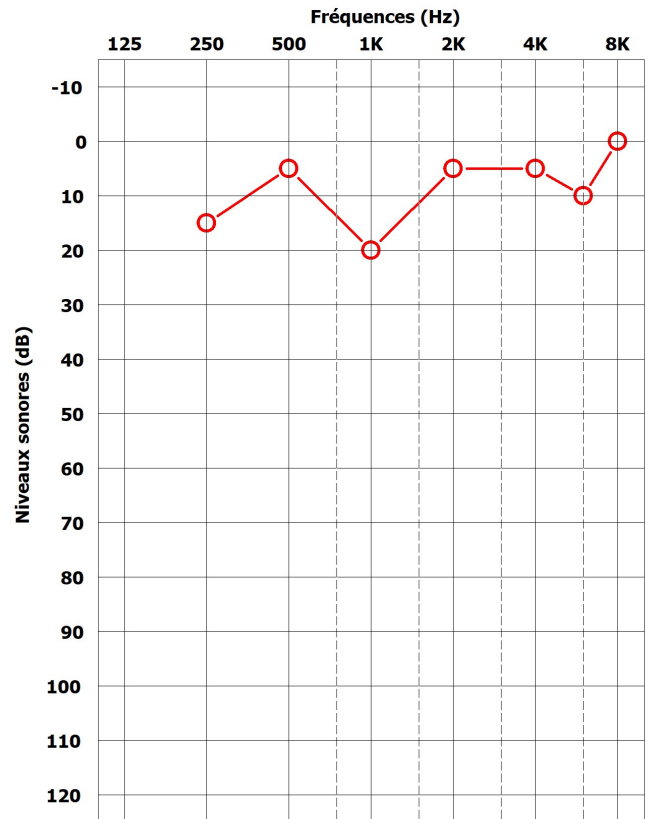

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20		0		5		0	0	0
CA Droit		15	5		20		5		5	10	0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	---	---
CA Droit	---	---

Notes