


MEDVIE


Date du test: 03/10/2024 17:16:57

Durée: 6mn 54s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

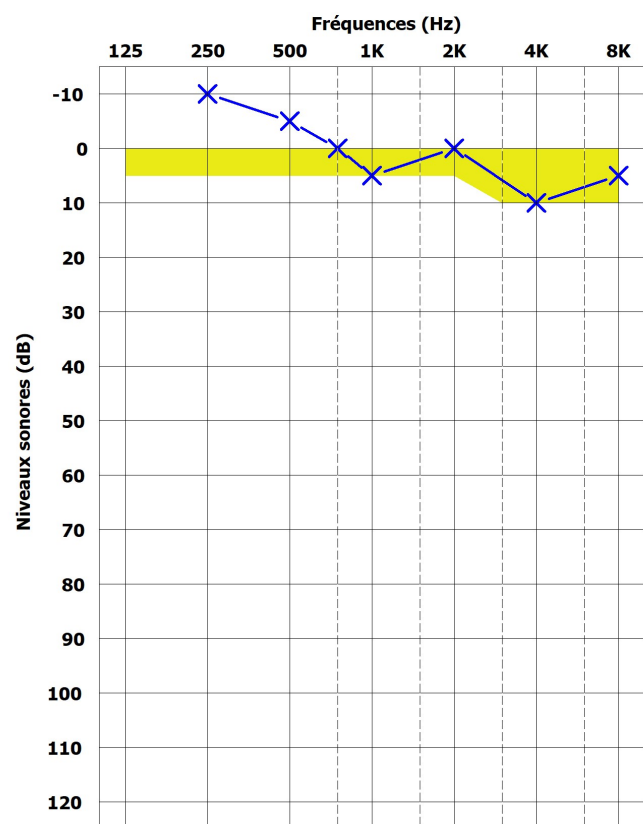

Oreille Gauche

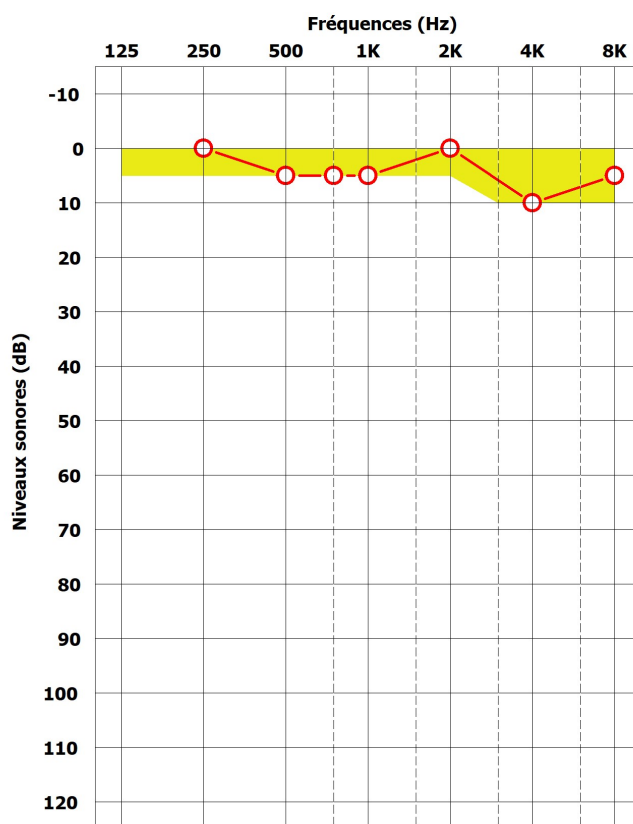

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-5	0	5		0		10		5
CA Droit		0	5	5	5		0		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient	KEITA MAMADY
Date de naissance	05/05/2003
Age	21
Société	CR18
ID	24100317153612211

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021