


MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 19:22:43

Durée: 7mn 16s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

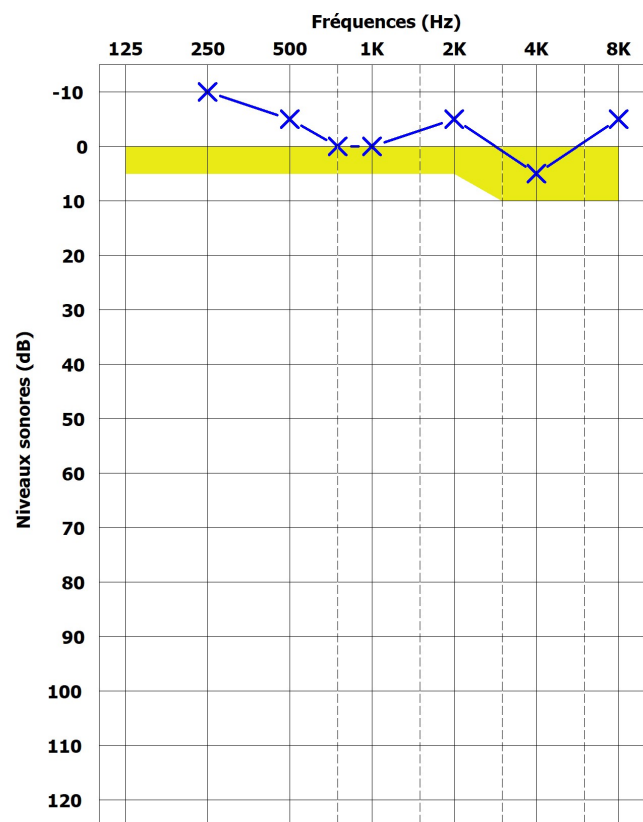

Oreille Gauche

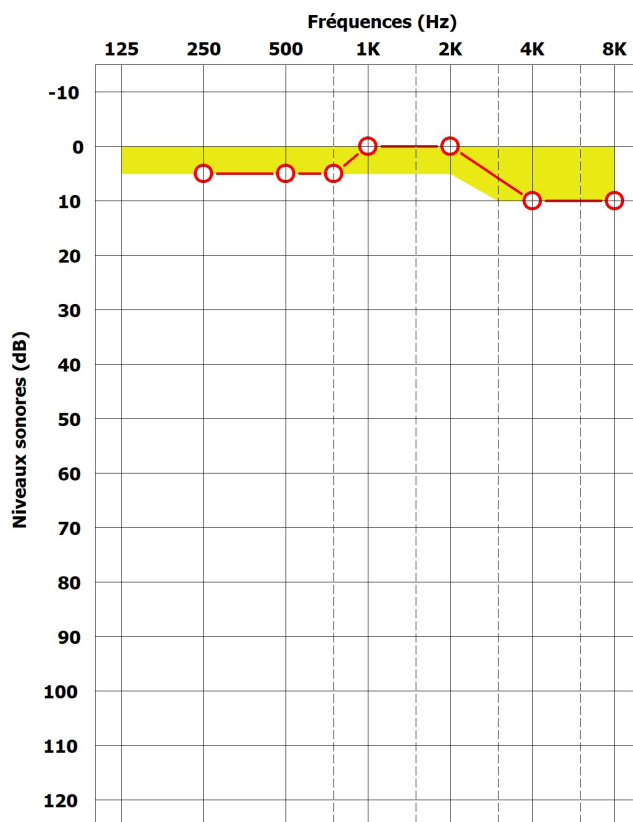

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | -10 | -5  | 0   | 0  |     | -5 |    | 5  |    | -5 |
| CA Droit  |     | 5   | 5   | 5   | 0  |     | 0  |    | 10 |    | 10 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | -1,3 dB | --- |
| CA Droit        | 3,8 dB  | --- |

Notes

| Données Patient   | KOUROUMA MAMADY   |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 01/01/2003        |
| Age               | 21                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 24092919002759356 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |