

Données Patient

CONDE MOHAMED

Date de naissance 09/05/1999
 Age 25
 Société CR18
 ID 24051709580416379

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211
 Numéro de série: 2111EAT690093
 Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 17/05/2024 10:03:07


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

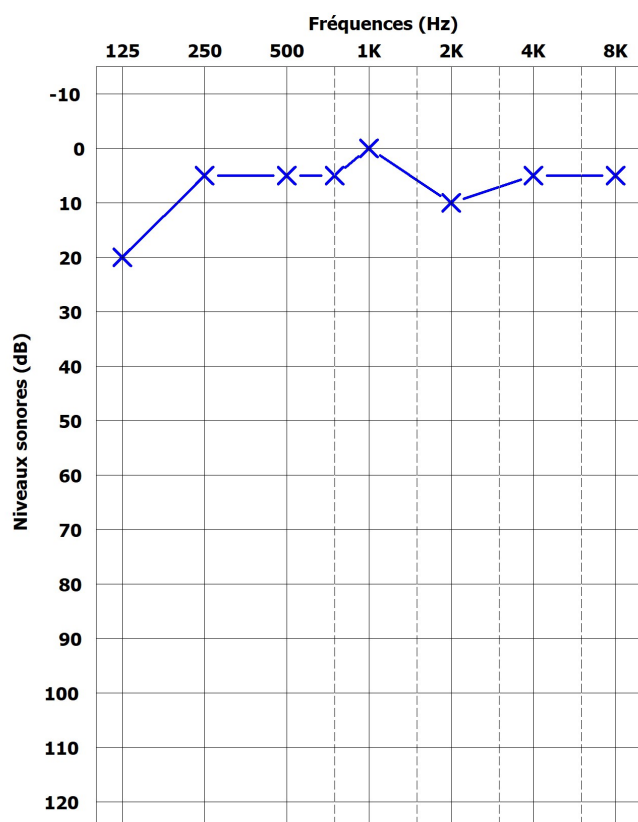

Oreille Gauche

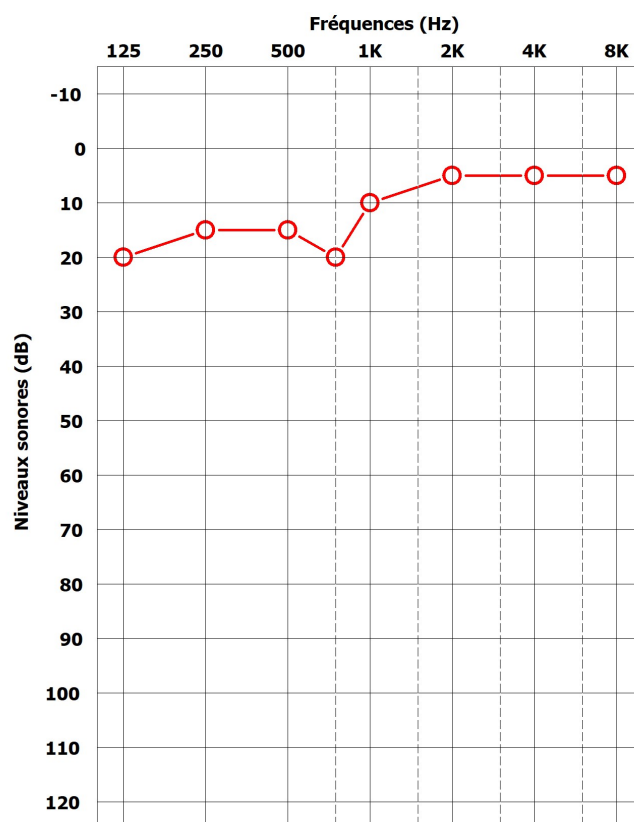

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	5	5	0		10		5		5
CA Droit	20	15	15	20	10		5		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes