

MEDVIE


Date du test: 07/03/2025 13:06:17

Durée: 3mn 44s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE AMADOU
Date de naissance	29/05/1995
Age	29
Société	CR18
ID	25030712585625311

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

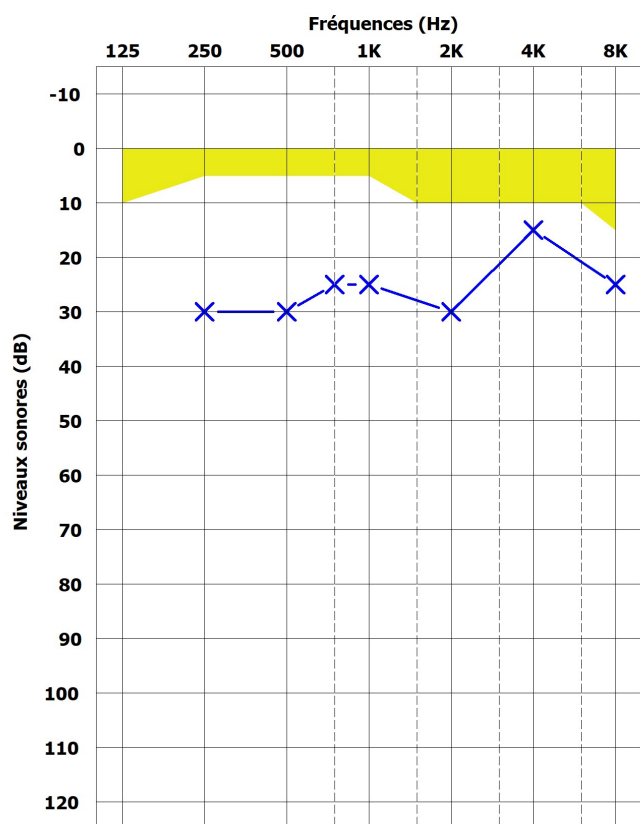

Oreille Gauche

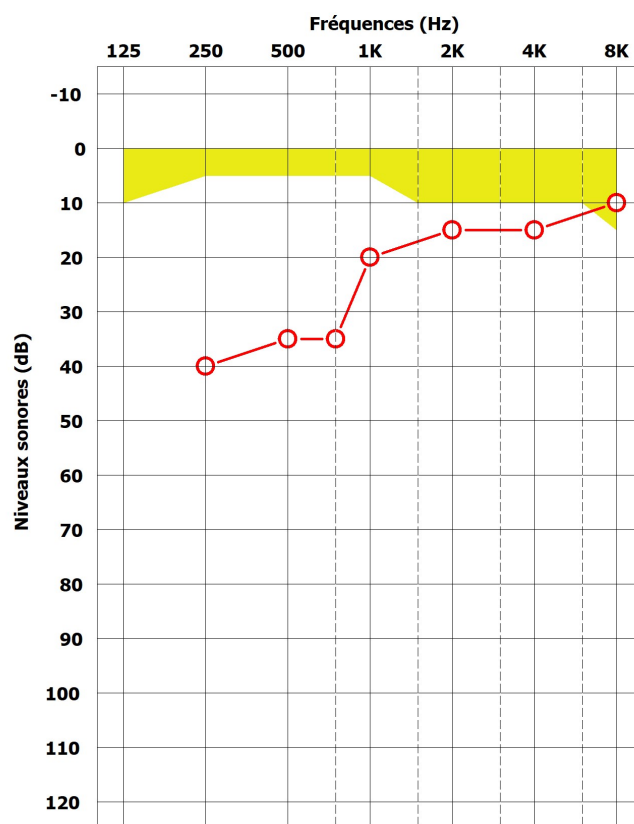

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	25		30		15		25
CA Droit		40	35	35	20		15		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes