


MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 10:06:33
Durée: 4mn 38s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TRAORE BAKARY
Date de naissance	01/01/1998	
Age	27	
Société	CR18	
ID	25031209561838855	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

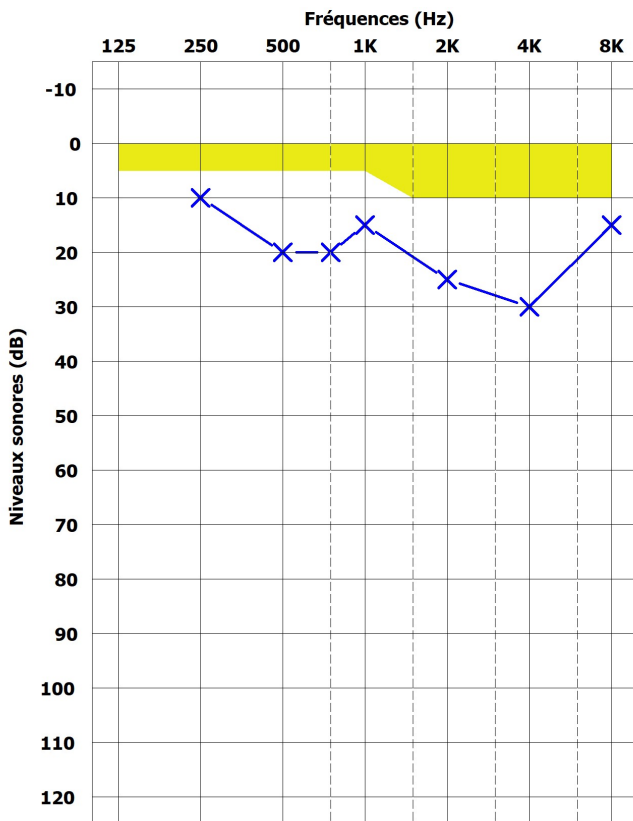

Oreille Gauche

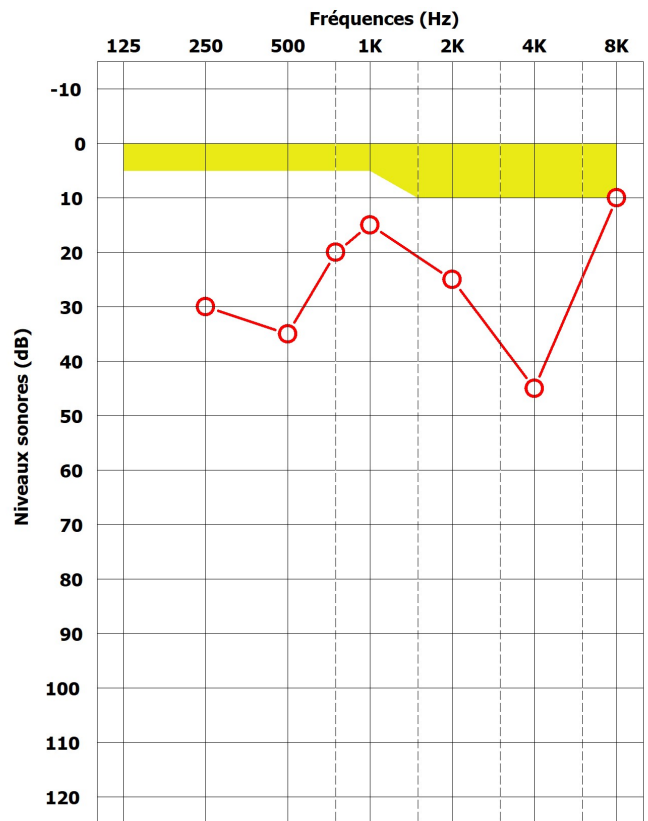

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20	20	15		25		30		15
CA Droit		30	35	20	15		25		45		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	30,0 dB	---

Notes