

MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 23:15:13

Durée: 9mn 04s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE SEKOU
Date de naissance	01/01/1985	
Age	39	
Société	CR18	
ID	24050123080235478	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

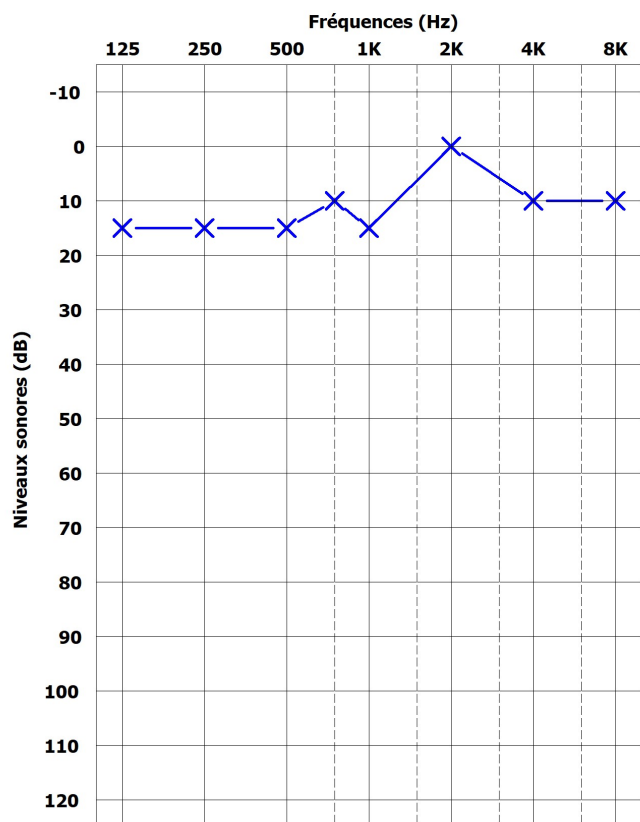

Oreille Gauche

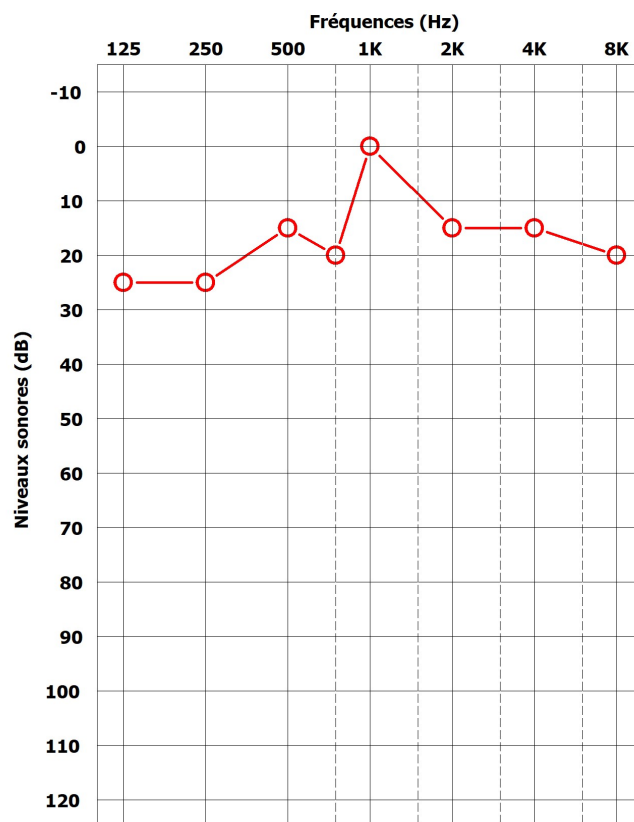

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	15	10	15		0		10		10
CA Droit	25	25	15	20	0		15		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes