ELECTRONICA MEDICAL
by Electronica Technologies

Données Patient	**CONDE ALSENY**
Date de naissance	08/03/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24121013355953809

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

Date du test: 10/12/2024 13:37:22
Durée: 4mn 43s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

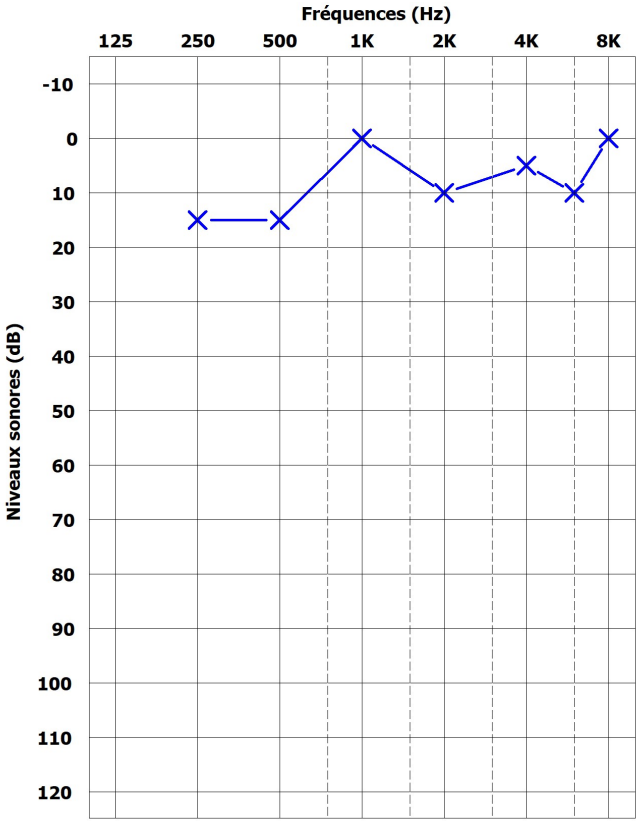

Oreille Gauche

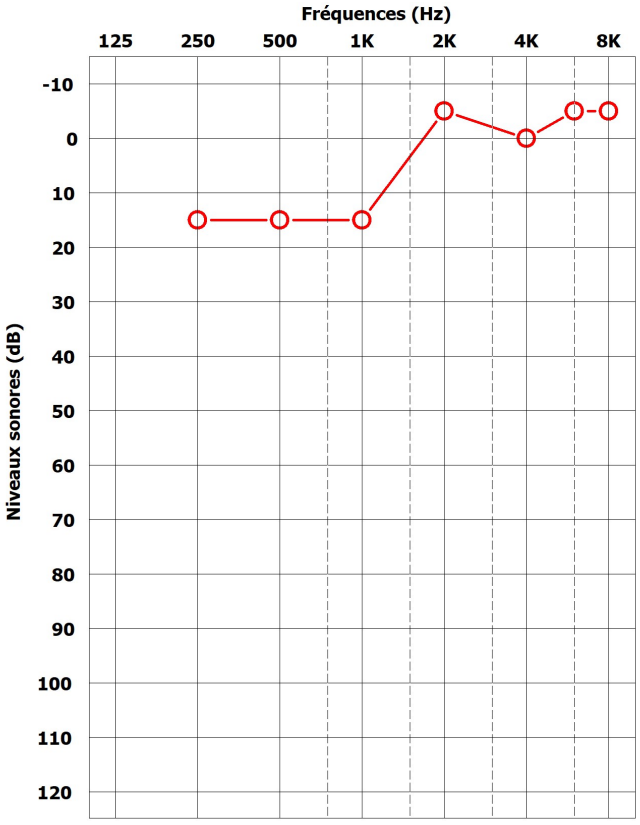

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15		0		10		5	10	0
CA Droit		15	15		15		-5		0	-5	-5

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	0,0 dB
CA Droit	---	15,0 dB

Notes

All rights reserved - Electronica Technologies 2020