


| | |
|-------------------|-------------------------|
| Données Patient | SOUMAORO YOUSOUF |
| Date de naissance | 01/01/1990 |
| Age | 34 |
| Société | CR18 |
| ID | 24031815443502986 |


MEDVIE

Date du test: 18/03/2024 15:47:31
 Durée: 6mn 52s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

| | |
|--------------------|-------------------|
| Audiomètre | |
| Type: | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série: | 2111EAT690093 |
| Date Calibration : | 30/11/2021 |

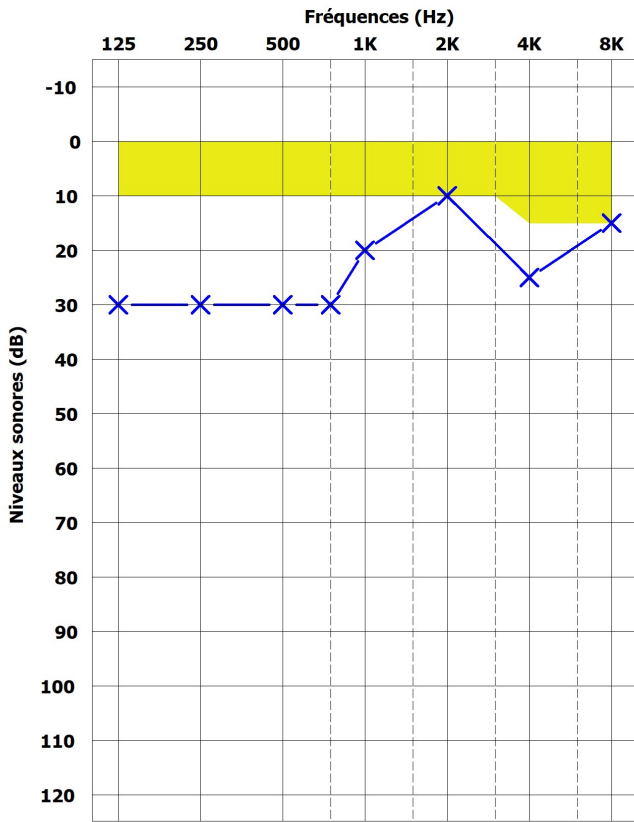

Oreille Gauche

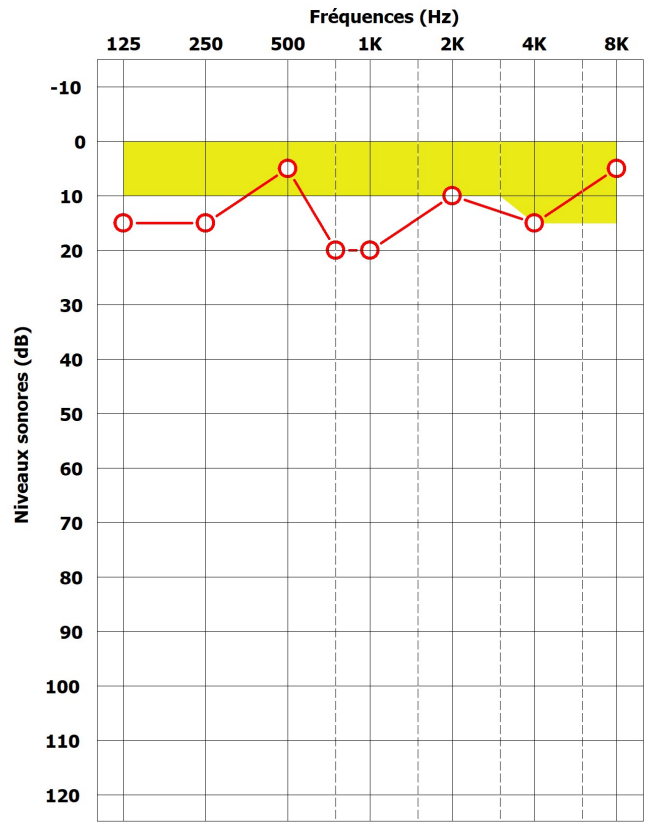

Oreille Droite

| | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | | 10 | | 25 | | 15 |
| CA Droit | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | | 10 | | 15 | | 5 |

| | | |
|-----------------|---------|-----|
| Calcul de perte | PAM | IPA |
| CA Gauche | 21,3 dB | --- |
| CA Droit | 12,5 dB | --- |

Notes