


MEDVIE

Date du test: 01/07/2025 13:35:48
Durée: 4mn 48s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	YU GUOLIANG
Date de naissance	05/01/1985
Age	40
Société	CR18
ID	25070112471136949

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

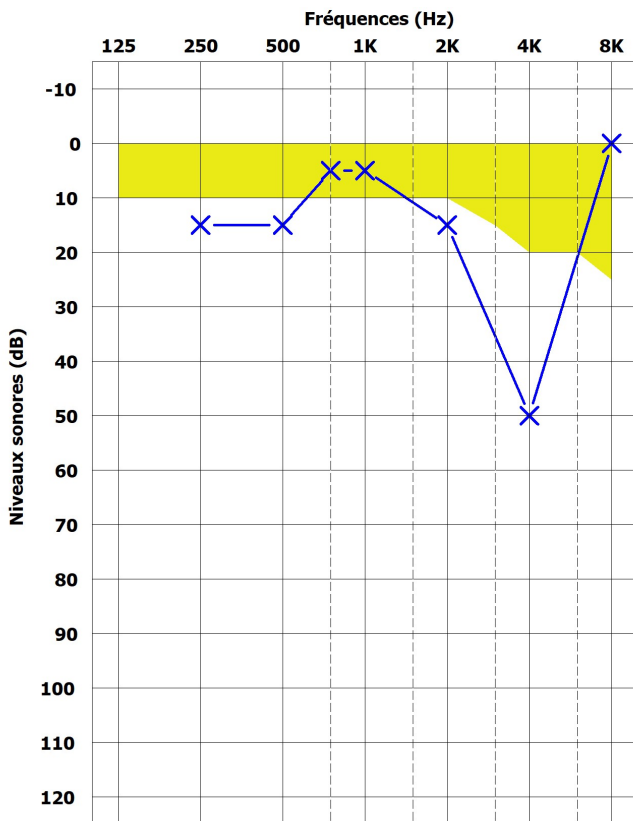

Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	5	5		15		50		0
CA Droit		20	25	10	0		20		50		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes