

MEDVIE


Date du test: 01/10/2024 15:46:23

Durée: 5mn 04s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BEAVOGUI JENNIFER TFNF	
Date de naissance	16/08/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24100115385673334

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

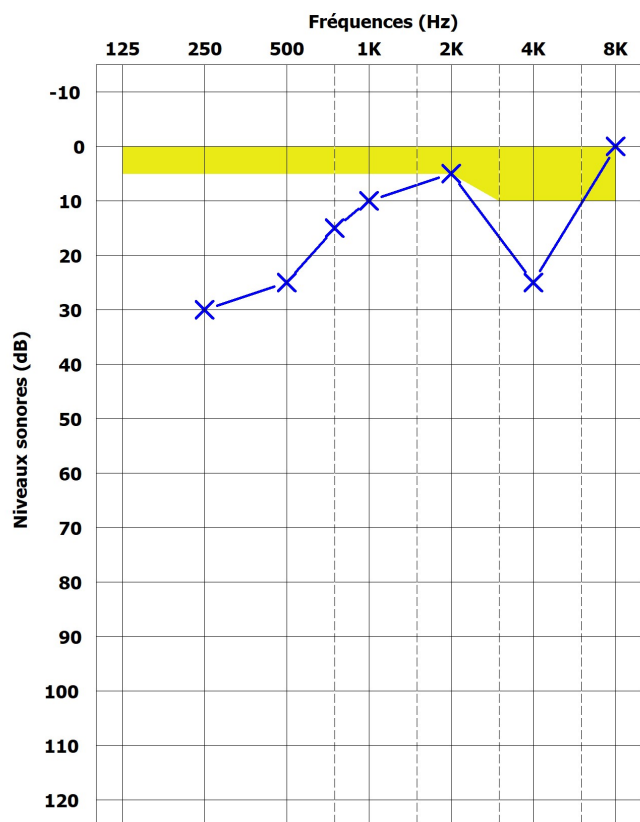

Oreille Gauche

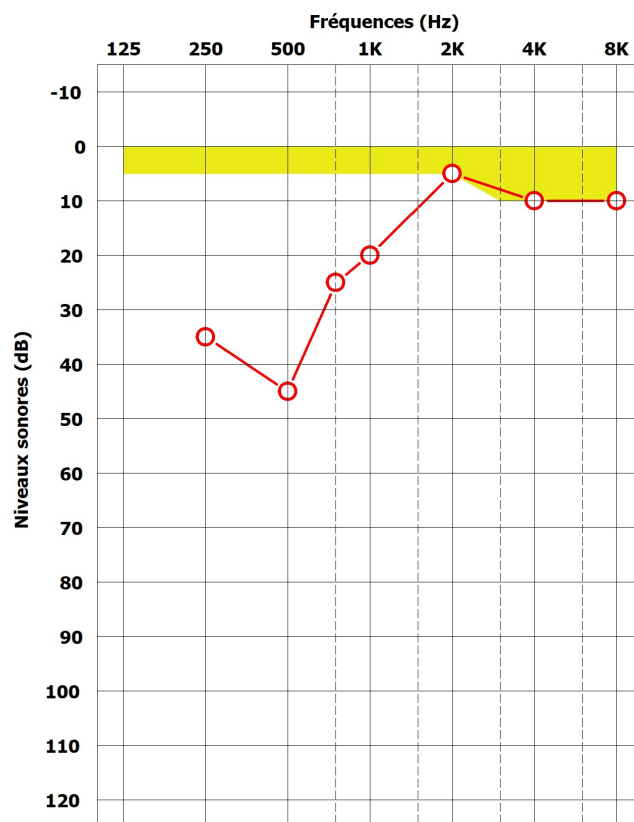

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	15	10		5		25		0
CA Droit		35	45	25	20		5		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes